

nuvita

MATERNO FLOW

- IT** Tiralatte elettrico indossabile
ES Sacaleches eléctrico manos libres
EN Wearable electric breast pump
FR Tire-lait électrique mains libres
DE Elektrische tragbare Milchpumpe
PT Bomba tira-leite elétrica vestível
GR Φορητό ηλεκτρικό
θήλαστρο (φορέσιμο)
NO Bærbar elektrisk
brystpumpe
DA Bærbar elektrisk
brystpumpe



1264W

- IT** Manuale istruzioni d'uso
ES Manual de instrucciones de uso
EN Instruction manual
FR Manuel d'instructions d'utilisation
DE Bedienungsanleitung

- PT** Manual de instruções de uso
GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
NO Bruksanvisning
DA Brugsanvisning

Grazie per aver acquistato il tiralatte elettrico indossabile Nuvita 1264W. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE VOSTRA E DEI VOSTRI BAMBINI, TUTTE LE INDICAZIONI IN QUESTO MANUALE SONO RELATIVE ALLA SICUREZZA. ASSICURARSI DI RISPETtarLE SEMPRE.

ATTENZIONE

1. Non utilizzare il tiralatte durante il bagno.
2. Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
3. Evitare di esporre il tiralatte ad alte temperature o alla luce diretta del sole.
4. Se il prodotto risulta danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato presso centri di manutenzione autorizzati.
5. Tenere tutte le parti non utilizzate fuori dalla portata dei bambini per evitare che vengano ingerite o causino incidenti.

PERICOLO

1. È vietato utilizzare o caricare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti dove la temperatura supera i 45°C.
2. È vietato immergere l'unità principale o il cavo di ricarica USB in liquidi, come acqua, benzina, bevande, ecc.
3. È vietato gettare l'unità principale nel fuoco o riscaldarla.
4. Non consentire ai bambini di giocare con sacchetti e imballaggi per evitare pericoli di soffocamento.

AVVISO

- Effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo.
- Durante l'assemblaggio, assicurarsi che ogni parte sia montata correttamente seguendo le istruzioni fornite.
- Regolare l'intensità di aspirazione in base alle proprie esigenze fisiche, per effettuare comodamente l'estrazione del latte.
- Non inclinare o riempire eccessivamente la bottiglia (non superare il livello massimo indicato).
- Prima dell'uso, controllare la temperatura del liquido nella bottiglia per evitare scottature.
- Si consiglia di utilizzare il tiralatte sotto la supervisione e le indicazioni di medici o personale sanitario qualificato.
- Non utilizzare eccessivamente il tiralatte per evitare lesioni al seno.
- Consultare uno specialista dell'allattamento o il proprio medico in caso di problemi o dolori.
- Le parti del tiralatte che entrano in diretto contatto con il latte materno sono articoli personali e le madri non dovrebbero condividerle con altre persone.

- Non utilizzare il tiralatte durante la gravidanza, poiché l'estrazione del latte potrebbe provocare aborto spontaneo.
- Non continuare a estrarre il latte per più di 5 minuti se non fuoriesce latte.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente agli scopi descritti nel manuale di istruzioni.

INFORMAZIONI

Il Nuvita 1264W Materno Flow è progettato per supportare le mamme che allattano, simulando il ritmo naturale di suzione del bambino. Questo tiralatte elettrico indossabile è specificamente pensato per aiutare le mamme a estrarre il latte materno in modo efficiente e confortevole anche fuori casa, offrendo un'esperienza di raccolta del latte efficace e confortevole. Dispone di 9 livelli di intensità regolabili, della tecnologia Careflo™ a 3 fasi e della funzione NipFit™.



MODALITÀ VIBRAZIONE INDIPENDENTE

La **Modalità Vibrazione** dedicata può essere utilizzata indipendentemente per massaggiare delicatamente il seno, aiutando a stimolare il flusso di latte e ad alleviare il disagio. Può anche essere attivata durante le modalità Stimolazione, Estrazione o Anti-Stasi per un supporto aggiuntivo.



ESTRAZIONE COMODA IN POSIZIONE RECLINATA

Progettato per l'uso da sedute con supporto per la schiena (inclinazione fino a 130°), rendendo il processo di estrazione più rilassante.



COPPETTA IN SILICONE DELICATA SULLA PELLE

Dotata di una coppetta in silicone morbido da 24 mm che si adatta delicatamente al seno per una vestibilità sicura e confortevole.



TECNOLOGIA CAREFLO™:

A differenza dei tiralatte tradizionali a 2 fasi, CareFlo™ introduce, oltre all'a fase di Stimolazione ed Estrazione anche una terza fase drenante anti-stasi per:

- favorire una produzione di latte più regolare
- prevenire gli ingorghi mammari e le mastiti
- alleviare la tensione e la pienezza mammaria
- dare maggiore continuità all'allattamento materno



FUNZIONE NIPFIT™:

Correzione del capezzolo piatto o introflesso.

Questa funzione è progettata per aiutare a correggere capezzoli piatti o introflessi e supportare l'estrazione del latte attraverso una stimolazione delicata e progressiva:

- Aiuta la protrusione del capezzolo verso l'esterno.
- Facilita l'attacco del bambino al seno.
- Supporta l'avvio e la continuità dell'allattamento.

CONTROINDICAZIONI

Non usare la funzione NipFit™ se:

1. Hai ferite aperte, ragadi, lesioni o infezioni attive al capezzolo o all'areola.
2. Hai avuto un intervento chirurgico recente al seno.
3. Hai una condizione diagnosticata di introversione del capezzolo causata da malattia o trauma, non congenita. In questo caso, consulta prima il medico.
4. Avverti dolore acuto fin dalla prima applicazione. Interrompi immediatamente l'utilizzo.
5. Hai una pelle particolarmente sensibile o soffri di condizioni dermatologiche locali, come eczema o psoriasi.
6. Sei in gravidanza. L'aspirazione può stimolare contrazioni.



ATTENZIONE

La funzione NipFit™ è indicata esclusivamente per il periodo post-partum. Non usare durante la gravidanza.


AVVERTENZE DURANTE L'USO

- Inizia sempre dal livello minimo, Livello 1. Non aumentare l'intensità prima che il capezzolo si sia adattato gradualmente, anche se la sensazione è confortevole.
- Non superare i 5-10 minuti di utilizzo continuativo della funzione NipFit™ per sessione, soprattutto nelle prime settimane.
- Non eseguire più di 2 sessioni di correzione al giorno. Un uso eccessivo può causare irritazione, edema o microlesioni al capezzolo.
- Interrompi immediatamente l'utilizzo in caso di dolore acuto, rossore anormale, gonfiore persistente, comparsa di vesciche o perdite di liquido diverse dal latte.
- Questo dispositivo non è un dispositivo medico certificato per terapia clinica e non sostituisce il consulto con un'ostetrica, un medico o una consulente IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant.
- Un capezzolo introflesso di grado 3, severamente aderente, richiede valutazione medica prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di correzione.
- L'uso prolungato ad alta intensità può causare edema dell'areola, rendendo temporaneamente più difficile l'attacco del neonato. Questo può generare un effetto opposto a quello desiderato.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO:

- Assicurarsi che la coppa in silicone sia della misura corretta, flangia 24 mm o riduttori 20/22 mm inclusi, prima di attivare la funzione NipFit™. Una coppa troppo grande può amplificare l'aspirazione sull'areola in modo non controllato.
- Prima della sessione, applicare qualche goccia di latte materno o crema alla lanolina pura per ammorbidire l'area.
- Durante la sessione NipFit™, il capezzolo deve essere centrato nella coppa. Una posizione scorretta può causare aspirazione asimmetrica e irritazione.
- Se dopo 4-6 settimane di utilizzo corretto non si nota alcun miglioramento, consultare un professionista sanitario.

COMPONENTI DEL PRODOTTO






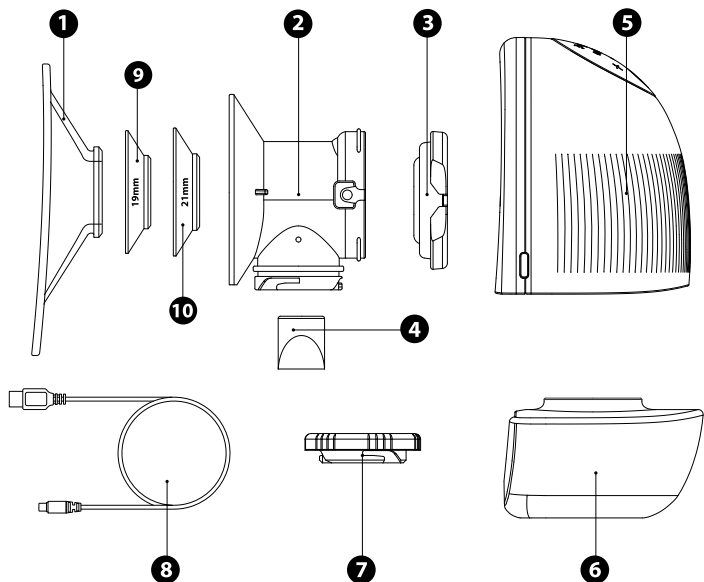


NO.	NOME	MATERIALE	TEMP. RESISTENZA	QUANTITÀ
1	Coppa in silicone	Silicone	-20~200°C	1
2	Corpo di assemblaggio	PP	-20~120°C	1
3	Valvola anti-riflusso	Silicone	-20~200°C	1
4	Valvola di non ritorno	Silicone	-20~200°C	2
5	Unità principale	/	/	1
6	Contenitore	Tritan	-20~105°C	1
7	Coperchio	PP	-20~120°C	1
8	Cavo USB	/	/	1
9	Riduttore 19mm	Silicone	-20~120°C	1
10	Riduttore 21mm	Silicone	-20~120°C	1

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

1. Inserire la valvola anti-riflusso **(3)** sul corpo di assemblaggio **(2)** in modo che le tacche su entrambi i lati siano allineate con le sporgenze presenti sui lati e premerlo per assicurarsi che aderisca perfettamente (come mostrato nella figura A).
2. Installare la valvola di non ritorno **(4)** sul cilindro sotto il corpo assemblaggio e inserirla fino in fondo per assicurare una perfetta tenuta (come mostrato nella figura B).
3. Allineare la sporgenza interna del connettore **(6)** con la scanalatura sotto il corpo assemblaggio e ruotare in senso orario. Dopo l'installazione, la linea centrale del contenitore e il corpo d'assemblaggio devono coincidere (come mostrato nella figura C).
4. Inserire il corpo d'assemblaggio ed il contenitore nell'unità principale nella direzione indicata in figura, assicurandosi che siano ben fissati in posizione (come mostrato nella figura D).
5. Allineare il simbolo "▲" sul silicone con il simbolo "▼" sull'unità principale, premendo il centro del silicone per garantire un accoppiamento perfetto con il corpo di assemblaggio (come mostrato nella figura E).

NOTA: Prima di iniziare l'estrazione del latte, verificare che tutti gli accessori siano correttamente assemblati e fissati saldamente.



METODO DI RICARICA


Questo prodotto utilizza un'interfaccia USB per il cavo di ricarica, che consente più modalità di alimentazione:

1. Collegamento a una porta USB del computer.
2. Collegamento con l'adattatore incluso (5V2A).
3. Collegamento a un power bank (utilizzare un power bank di qualità per evitare danni al prodotto).

Il dispositivo riconosce automaticamente il livello della batteria.

- Lo schermo dell'unità principale è dotato di un simbolo di alimentazione della batteria per indicare la carica attuale. Se il simbolo della batteria "🔋" lampeggia durante l'accensione o l'uso, significa che l'unità principale deve essere ricaricata tempestivamente.
- Una volta collegato il dispositivo all'alimentazione per la ricarica, il simbolo della batteria "🔋" lampeggia per indicare che la batteria è in carica. Quando la batteria è completamente carica, il simbolo "🔋" rimane fisso.

NOTA: Spegnerne il dispositivo prima di collegarlo all'alimentatore per la ricarica.



DESCRIZIONE DEL PANNELLO

A1: Pulsante Accensione/Selezione modalità: premere a lungo per accendere o spegnere, premere brevemente per cambiare modalità di funzionamento.

A2: Pulsante per diminuire l'intensità

A3: Pulsante per aumentare l'intensità

A2+A3: Nelle modalità stimolazione/estrazione/anti-stasi, premere contemporaneamente i pulsanti A2+A3 per aggiungere la funzione di vibrazione extra alla modalità di lavoro attuale. Premere nuovamente per disattivare la funzione vibrazione.

B1: Indicatore modalità stimolazione


B2: Indicatore modalità estrazione.

B3: Indicatore modalità anti-stasi.

B4: Indicatore modalità vibrazione.

B5: Indicatore livello e tempo (quando viene modificata la modalità di lavoro, prima viene visualizzata la modalità corrente, e poi il tempo di funzionamento).

B1+B3: Funzione NipFit™ attivata



MODALITÀ STIMOLAZIONE (LIVELLO 1~5): In questa modalità, il tiralatte genera un ritmo di suzione relativamente rapido con una potenza di aspirazione bassa. È progettata per stimolare delicatamente i tessuti del seno e favorire l'estrazione del latte imitando il comportamento iniziale di suzione superficiale di un neonato. Si raccomanda di utilizzare questa modalità prima di passare ad altre modalità.

MODALITÀ ESTRAZIONE (LIVELLO 1~9): Questa modalità imita il ritmo di suzione più profondo e lento di un neonato durante l'allattamento attivo. La forza di aspirazione è più elevata e la frequenza è più lenta rispetto alla modalità stimolazione. Questa impostazione è pensata per aiutare a estrarre il latte in modo più efficace una volta che è iniziata l'estrazione.

MODALITÀ ANTI-STASI (LIVELLO 1~9): Questa modalità agisce in maniera pulsata ed è mirata a rimuovere accuratamente il latte residuo nel seno dopo l'estrazione. L'uso regolare può aiutare a prevenire la stasi latte, ridurre il rischio di dotti ostruiti e mantenere il flusso di latte.




MODALITÀ VIBRAZIONE (LIVELLO 1~3): Il tiralatte utilizza 13.000 impulsi delicati al minuto per stimolare in profondità il seno, contribuendo a liberare i dotti lattiferi e facilitare l'estrazione del latte.

FUNZIONE NIPFIT™: Per attivare la funzione di correzione del capezzolo, premere il pulsante modalità fino a quando le icone (B1) e (B3) iniziano a lampeggiare. La funzione dispone di 3 livelli di intensità.


NOTA: Durante le modalità di stimolazione ed estrazione, la vibrazione funziona a un'intensità preimpostata fissa e non può essere regolata. La velocità di vibrazione può essere aumentata o diminuita solo quando si utilizza la modalità solo vibrazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare accuratamente le mani prima dell'uso. Assicurarsi che tutti i componenti del tiralatte siano stati accuratamente puliti e assemblati correttamente seguendo le istruzioni. (Prima di iniziare l'estrazione, è consigliabile usare un asciugamano caldo per comprimere e massaggiare il seno, per facilitare l'estrazione del latte).
2. Posizionare il tiralatte assemblato all'interno del reggiseno, regolandone l'angolazione in modo che aderisca perfettamente al seno (come mostrato nella figura 1).
3. Premere a lungo il pulsante Accensione/Selezione modalità (A1) per accendere il dispositivo, che entrerà automaticamente nella modalità di stimolazione (livello predefinito di stimolazione: 3). Dopo 2 minuti di funzionamento, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità di estrazione (livello predefinito: 5) (come mostrato nella figura 2).
4. Durante il funzionamento, premere brevemente il pulsante (A1) per passare ciclicamente da una modalità di lavoro all'altra (come mostrato nella figura 3).



5. Durante il funzionamento, premere brevemente i pulsanti (A2) e (A3) per regolare il livello di intensità della modalità in uso (come mostrato nella figura 4).
6. Durante il funzionamento, premere contemporaneamente i pulsanti (A2) e (A3) per aggiungere la "modalità vibrazione" alla modalità di funzionamento corrente. Premere nuovamente per disattivare la funzione vibrazione (come mostrato nella figura 4).
7. Funzione memoria: il dispositivo ricorda l'ultimo livello di funzionamento utilizzato nelle modalità stimolazione, estrazione, anti-stasi e vibrazione, facilitando l'utilizzo con un solo pulsante.
8. Durante il funzionamento, premere a lungo il pulsante (A1) per spegnere il dispositivo.
9. Al termine dell'estrazione del latte, rimuovere il biberon e trasferire il latte materno in un contenitore adeguato per la conservazione (come mostrato nella figura 5).



NOTA: Verificare in qualsiasi momento la quantità di latte per evitare eventuali fuoriuscite. Il tiralatte si fermerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento continuo nelle modalità stimolazione ed estrazione, e dopo 5 minuti nella modalità anti-stasi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

A. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare il tiralatte per la prima volta, pulire e disinfettare accuratamente tutti i componenti (eccetto l'unità principale e il cavo USB), seguendo le istruzioni di pulizia e disinfezione nelle sezioni B e C qui di seguito.

B. DOPO OGNI UTILIZZO

Pulire accuratamente tutte le parti (eccetto l'unità principale) che entrano in contatto diretto con il seno e il latte materno. Smontare il tiralatte in parti separate e risciacquare tutte le parti che entrano in contatto con il seno e il latte materno con acqua tiepida per rimuovere ogni residuo.

C. DISINFEZIONE GIORNALIERA

- Lavare accuratamente le mani.
- Separare tutte le parti che entrano in contatto diretto con il seno e il latte materno.
- Versare acqua fredda in un recipiente (in quantità sufficiente per immergere completamente tutte le parti).
- Dopo aver portato l'acqua a ebollizione, immergere le parti per circa 5 minuti, quindi rimuoverle delicatamente con una pinza.
- Appoggiare le parti sterilizzate su un asciugamano pulito.
- Conservare le parti in un luogo asciutto. Evitare di conservarle in ambienti bui e umidi quando non sono in uso.
- Durante la disinfezione, gli accessori non devono entrare a diretto contatto con le pareti metalliche del recipiente (è consigliabile usare una garza pulita come separatore tra le parti e il recipiente).
- E' possibile in alternativa utilizzare uno sterilizzatore a vapore.

PRECAUZIONI PER LA PULIZIA

- Smontare sempre tutti gli accessori che entrano in contatto diretto con il seno o il latte materno (eccetto l'unità principale).
- Dopo ogni utilizzo, pulire immediatamente le parti per evitare residui di latte e la proliferazione di batteri.
- Durante l'assemblaggio o lo smontaggio, assicurarsi di seguire le istruzioni per ciascun componente.
- Durante lo smontaggio e la pulizia, prestare attenzione a non perdere alcuna parte, per evitare malfunzionamenti durante l'assemblaggio o l'utilizzo del prodotto.
- Il silicone per stimolazione, il silicone anti-riflusso e altri accessori (eccetto l'unità principale) possono essere sterilizzati nello sterilizzatore.
- Precauzioni per la disinfezione della valvola: **NON** bollire o sterilizzare a vapore per più di 3 minuti.
- Il contenitore è realizzato in materiale Tritan e **NON** è adatto alla sterilizzazione a vapore caldo; si raccomanda invece la sterilizzazione a freddo.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome prodotto	1264W Materno Flow
Tensione di ingresso	5V
Potenza nominale	6W
Tensione batteria	3.7V
Garanzia	1 anno
Capacità batteria	1300mAh 4.81Wh
Luogo di produzione	PRC

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o fattura. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale si riduce a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi non include danni derivanti dalla normale usura del prodotto, danni estetici, accessori o materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi. Termini e condizioni di garanzia dettagliati su www.nuvitababy.com/warranty

Gracias por haber adquirido el sacaleches eléctrico portátil Nuvita 1264W. Lea atentamente el manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR SU SEGURIDAD Y LA DE SU BEBÉ, TODAS LAS INDICACIONES DE ESTE MANUAL SE REFIEREN A LA SEGURIDAD. ASEGÚRESE DE SEGUIRLAS SIEMPRE.

ATENCIÓN

- No utilice el sacaleches durante el baño.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Evite exponer el sacaleches a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- Si el producto está dañado, para evitar peligros debe ser reemplazado por el fabricante o por personal calificado en centros de mantenimiento autorizados.
- Mantenga todas las piezas no utilizadas fuera del alcance de los niños para evitar que sean ingeridas o causen accidentes.

PELIGRO

- Está prohibido usar o cargar el producto cerca de fuentes de calor o en ambientes donde la temperatura supere los 45°C.
- Está prohibido sumergir la unidad principal o el cable de carga USB en líquidos como agua, gasolina, bebidas, etc.
- Está prohibido arrojar la unidad principal al fuego o calentarla.
- No permita que los niños jueguen con bolsas o embalajes para evitar peligros de asfixia.

AVISO

- Realice una carga completa antes del primer uso.
- Durante el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén correctamente colocadas siguiendo las instrucciones proporcionadas.
- Regule la intensidad de succión según sus necesidades físicas, para extraer la leche cómodamente.
- No incline ni llene excesivamente el biberón (no superar el nivel máximo indicado).
- Antes del uso, verifique la temperatura del líquido en el biberón para evitar quemaduras.
- Se recomienda utilizar el sacaleches bajo la supervisión e indicaciones de médicos o personal sanitario cualificado.
- No utilice el sacaleches en exceso para evitar lesiones en los senos.
- Consulte a un especialista en lactancia o a su médico en caso de problemas o dolores.
- Las partes del sacaleches que entran en contacto directo con la leche materna son artículos personales y las madres no deberían compartirlas con otras personas.
- No utilice el sacaleches durante el embarazo, ya que la extracción de leche podría provocar un aborto espontáneo.

- No continúe extrayendo leche durante más de 5 minutos si no sale leche.
- Este producto está destinado exclusivamente a los fines descritos en el manual de instrucciones.

INFORMACIÓN

El Nuvita 1264W Materno Flow está diseñado para acompañar a las mamás durante la lactancia, imitando el ritmo natural de succión del bebé. Este extractor de leche eléctrico y manos libres está pensado específicamente para que puedas extraer leche de forma cómoda y eficiente incluso fuera de casa, garantizando una experiencia práctica y sin molestias. Cuenta con 9 niveles de intensidad regulables, la función NipFit™ y la tecnología de 3 fases CareFlo™.



MODO DE VIBRACIÓN INDEPENDIENTE

El **Modo de Vibración** dedicado puede utilizarse de forma independiente para masajear suavemente el pecho, ayudando a estimular el flujo de leche y a aliviar molestias. También puede activarse durante los modos Estimulación, Extracción o Anti-Estasis como apoyo adicional.



EXTRACCIÓN CÓMODA EN POSICIÓN RECLINADA

Diseñado para usarse sentada con soporte para la espalda (inclinación de hasta 130°), haciendo el proceso de extracción más relajante.



COPA DE SILICONA SUAVE PARA LA PIEL Equipado con una copa de silicona blanda de 24 mm que se adapta delicadamente al pecho para un ajuste seguro y cómodo.



TECNOLOGÍA CAREFLO™:

A diferencia de los extractores tradicionales de 2 fases, el sistema CareFlo™ añade una tercera fase de drenaje anticongestión a las etapas habituales de estimulación y extracción. Sus beneficios incluyen:

- Estimular una producción de leche más constante.
- Prevenir la obstrucción de los conductos y la mastitis.
- Aliviar la tensión y la sensación de pecho lleno.
- Favorecer una lactancia materna más prolongada y sin interrupciones.



FUNCIÓN NIPFIT™:

Corrección del pezón plano o invertido. Esta función está diseñada para ayudar a corregir los pezones planos o invertidos. Facilita la extracción de leche mediante una estimulación suave y progresiva que:

- Ayuda a conseguir la protrusión del pezón hacia el exterior.
- Facilita el agarre del bebé al pecho.
- Favorece el inicio y la continuidad de la lactancia.

CONTRAINDICACIONES

No utilice la función NipFit™ si:

1. Tiene llagas abiertas, grietas, lesiones o infecciones activas en el pezón o la areola.
2. Se ha sometido recientemente a una cirugía de mama.
3. Tiene un diagnóstico de inversión del pezón causado por una enfermedad o traumatismo, no congénito. En ese caso, consulte primero a su médico.
4. Experimenta dolor agudo con la primera aplicación. Suspenda su uso inmediatamente.
5. Tiene la piel especialmente sensible o padece afecciones dermatológicas locales, como eccema o psoriasis.
6. Está embarazada. La succión puede estimular las contracciones.



ADVERTENCIA

La función NipFit™ está diseñada únicamente para uso posparto. No la utilice durante el embarazo.


ADVERTENCIAS DURANTE EL USO

- Comience siempre con el nivel más bajo, Nivel 1. No aumente la intensidad hasta que el pezón se haya adaptado gradualmente, incluso si la sensación es cómoda.
- No exceda los 5-10 minutos de uso continuo de la función NipFit™ por sesión, especialmente durante las primeras semanas.
- No realice más de 2 sesiones de corrección al día. El uso excesivo puede causar irritación, hinchazón o microdesgarros en el pezón.
- Suspenda su uso inmediatamente si experimenta dolor agudo, enrojecimiento anormal, hinchazón persistente, ampollas o secreción de líquido que no sea leche.
- Este dispositivo no es un dispositivo médico certificado para terapia clínica y no reemplaza la consulta con una matrona, un médico o un consultor internacional certificado en lactancia (IBCLC).
- Un pezón invertido de grado 3, con adherencia severa, requiere evaluación médica antes de usar cualquier dispositivo de corrección.
- El uso prolongado y de alta intensidad puede causar hinchazón de la areola, lo que dificulta temporalmente que el bebé se agarre al pecho. Esto puede tener el efecto contrario al deseado.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO:

- Asegúrese de que la copa de silicona sea del tamaño correcto, incluyendo el embudo de 24 mm o los reductores de 20/22 mm, antes de activar la función NipFit™. Una copa demasiado grande puede aumentar la succión en la areola de forma descontrolada.
- Antes de la sesión, aplique unas gotas de leche materna o crema de lanolina pura para suavizar la zona.
- Durante la sesión con NipFit™, el pezón debe estar centrado en la copa. Una posición incorrecta puede causar succión asimétrica e irritación.
- Si no observa ninguna mejoría después de 4 a 6 semanas de uso correcto, consulte a un profesional de la salud.

COMPONENTI DEL PRODOTTO






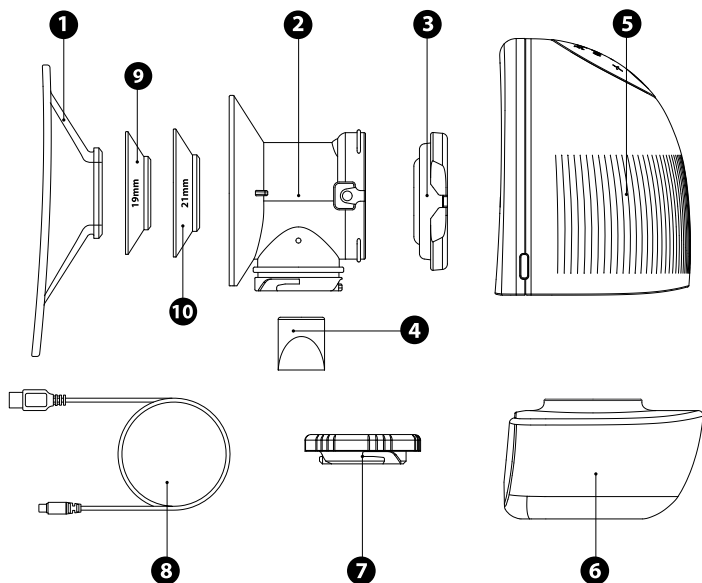


NO.	NOMBRE	MATERIAL	RESISTENCIA TÉRMICA	CANTIDAD
1	Copa de silicona	Silicona	-20~200°C	1
2	Cuerpo de ensamblaje	PP	-20~120°C	1
3	Válvula antirretorno	Silicona	-20~200°C	1
4	Válvula de no retorno	Silicona	-20~200°C	2
5	Unidad principal	/	/	1
6	Contenedor	Tritán	-20~105°C	1
7	Tapa	PP	-20~120°C	1
8	Cable USB	/	/	1
9	Reductor 19mm	Silicone	-20~120°C	1
10	Reductor 21mm	Silicone	-20~120°C	1

ISTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Inserta la válvula antirretorno (3) en el cuerpo de ensamblaje (2) de manera que las muescas de ambos lados se alineen con las salientes presentes en los laterales y presiónala para asegurarte de que se adhiera correctamente (como se muestra en la figura A).
2. Instala la válvula de no retorno (4) en el cilindro debajo del cuerpo de ensamblaje e insértala hasta el fondo para asegurar un sellado perfecto (como se muestra en la figura B).
3. Alinea la saliente interna del conector (6) con la ranura debajo del cuerpo de ensamblaje y gira en el sentido de las agujas del reloj. Después de la instalación, la línea central del recipiente y el cuerpo de ensamblaje deben coincidir (como se muestra en la figura C).
4. Inserta el cuerpo de ensamblaje y el recipiente en la unidad principal en la dirección indicada en la figura, asegurándote de que estén correctamente fijados en su posición (como se muestra en la figura D).
5. Alinea el símbolo "▲" del silicón con el símbolo "▼" de la unidad principal, presionando el centro del silicón para garantizar un acoplamiento perfecto con el cuerpo de ensamblaje (como se muestra en la figura E).

NOTA: Prima di iniziare l'estrazione del latte, verificare che tutti gli accessori siano correttamente assemblati e fissati saldamente.



MÉTODO DE CARGA


Este producto utiliza una interfaz USB para el cable de carga, lo que permite tres modos de alimentación:

1. Conexión a un puerto USB del ordenador.
2. Conexión con el adaptador incluido (5V2A).
3. Conexión a un power bank (utilizar un power bank de buena calidad para evitar daños al producto).

El dispositivo reconoce automáticamente el nivel de batería

- La pantalla de la unidad principal está equipada con un símbolo de batería para indicar el nivel actual de carga. Si el símbolo de la batería "  " parpadea durante el encendido o uso, significa que la unidad principal debe recargarse lo antes posible.
- Una vez conectado el dispositivo a la alimentación para la carga, el símbolo de la batería "  " parpadeará para indicar que se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el símbolo "  " permanecerá fijo.

NOTA: *Apaga el dispositivo antes de conectarlo a la fuente de alimentación para cargarlo.*



DESCRIPCIÓN DEL PANEL

A1: Botón de encendido / selección de modo: mantener presionado para encender o apagar, pulsar brevemente para cambiar el modo de funcionamiento.

A2: Botón para disminuir la intensidad.

A3: Botón para aumentar la intensidad.

A2+A3: En los modos de estimulación / extracción / anti-estasis, presionar simultáneamente los botones A2 + A3 para activar la función de vibración adicional al modo actual de trabajo. Presionar nuevamente para desactivar la función de vibración.

B1: Indicador del modo de estimulación.


B2: Indicador del modo de extracción.

B3: Indicador del modo anti-estasis.

B4: Indicador de vibración.

B5: Indicador de nivel e intervalo de tiempo (cuando se cambia el modo de trabajo, primero se visualiza el modo actual, seguido por el tiempo de funcionamiento).

B1+B3: Función NipFit™ activada

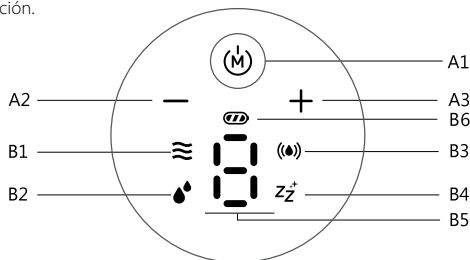

MODO ESTIMULACIÓN (NIVELES 1~5): En este modo, el sacaleches genera un ritmo de succión relativamente rápido con una potencia de aspiración baja. Está diseñado para estimular suavemente los tejidos del pecho y favorecer la extracción de leche imitando el comportamiento inicial de succión superficial de un recién nacido. Se recomienda usar este modo antes de pasar a otros modos.

MODO EXTRACCIÓN (NIVELES 1~9): Este modo imita el ritmo de succión más profundo y lento de un recién nacido durante la lactancia activa. La fuerza de succión es más elevada y la frecuencia es menor en comparación con el modo estimulación. Esta configuración está pensada para ayudar a extraer la leche de forma más eficaz una vez que ha comenzado la extracción.

MODO ANTI-ESTASIS (NIVELES 1~9): Este modo actúa en forma de pulsaciones y está dirigido a eliminar cuidadosamente la leche residual del pecho después de la extracción. Su uso regular puede ayudar a prevenir la estasis de leche, reducir el riesgo de obstrucción de conductos y mantener un flujo adecuado de leche.



MODO DE VIBRACIÓN (NIVELES 1~3): El sacaleches utiliza 13.000 impulsos suaves por minuto para estimular en profundidad el pecho, ayudando a liberar los conductos galactóforos y facilitar la extracción de la leche.

FUNCIÓN NIPFIT™: Para activar la función de corrección de pezones, pulse el botón de modo hasta que los iconos (B1) y (B3) empiecen a parpadear. La función tiene 3 niveles de intensidad.

NOTA: Durante los modos de estimulación y extracción, la vibración funciona a una intensidad preestablecida y no se puede ajustar. La velocidad de vibración solo se puede aumentar o disminuir en el modo de solo vibración.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Lávese bien las manos antes del uso. Asegúrese de que todos los componentes del sacaleches estén bien limpios y ensamblados correctamente siguiendo las instrucciones. (Antes de comenzar la extracción, se recomienda usar una toalla tibia para comprimir y masajear el pecho, facilitando así la extracción de la leche).
2. Coloque el sacaleches ensamblado dentro del sujetador, ajustando la inclinación para que se adhiera perfectamente al pecho (como se muestra en la figura 1).
3. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Selección de modo (A1) para encender el dispositivo, que entrará automáticamente en el modo de estimulación (nivel predeterminado de estimulación: 3). Después de 2 minutos de funcionamiento, el dispositivo cambiará automáticamente al modo de extracción (nivel predeterminado: 5) (como se muestra en la figura 2).



4. Durante el funcionamiento, pulse brevemente el botón (A1) para pasar cíclicamente de un modo de funcionamiento a otro (como se muestra en la figura 3).

5. Durante el funcionamiento, pulse brevemente los botones (A2) y (A3) para ajustar el nivel de intensidad del modo en uso (como se muestra en la figura 4).



6. Durante el funcionamiento, mantenga pulsados simultáneamente los botones (A2) y (A3) para activar el "modo vibración" en el modo de funcionamiento actual. Presione nuevamente para desactivar la función de vibración (como se muestra en la figura 4).



7. Función memoria: el dispositivo recuerda el último nivel de funcionamiento utilizado en los modos estimulación, extracción, anti-estasis y vibración, facilitando su uso con un solo botón.

8. Durante el funcionamiento, mantenga pulsado el botón (A1) para apagar el dispositivo.

9. Al final de la extracción de leche, retire el biberón y transfiera la leche materna a un recipiente adecuado para su conservación (como se muestra en la figura 5).

NOTA: Verifique en todo momento la cantidad de leche para evitar posibles desbordamientos. El extractor de leche se detendrá automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento continuo en los modos de estimulación y extracción, y después de 5 minutos en el modo anti-estasis.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A. ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar el sacaleches por primera vez, limpie y desinfecte cuidadosamente todos los componentes (excepto la unidad principal y el cable USB), siguiendo las instrucciones de limpieza y desinfección indicadas en las secciones B y C a continuación.

B. DESPUÉS DE CADA USO

Limpie cuidadosamente todas las piezas (excepto la unidad principal) que entren en contacto directo con el pecho y la leche materna. Desmonte el extractor en partes separadas y enjuague con agua tibia todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna para eliminar cualquier residuo.

C. DESINFECCIÓN DIARIA

- Lávese bien las manos.
- Separe todas las piezas que entren en contacto directo con el pecho y la leche materna.
- Vierta agua fría en un recipiente (en cantidad suficiente para sumergir completamente todas las piezas).
- Después de llevar el agua a ebullición, sumerge las piezas durante unos 5 minutos, luego retíralas cuidadosamente con unas pinzas.
- Coloca las piezas esterilizadas sobre una toalla limpia.
- Guarda las piezas en un lugar seco. Evita almacenarlas en ambientes oscuros y húmedos cuando no estén en uso.

- Durante la desinfección, los accesorios no deben entrar en contacto directo con las paredes metálicas del recipiente (se recomienda usar una gasa limpia como separador entre las piezas y el recipiente).
- È possibile in alternativa utilizzare uno sterilizzatore a vapore

PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA

- Desmonta siempre todos los accesorios que entran en contacto directo con el pecho o con la leche materna (excepto la unidad principal).
- Después de cada uso, limpia inmediatamente las piezas para evitar residuos de leche y la proliferación de bacterias.
- Durante el montaje o desmontaje, asegúrate de seguir las instrucciones para cada componente.
- Durante el desmontaje y la limpieza, presta atención a no perder ninguna pieza, para evitar fallos durante el montaje o el uso del producto.
- Los componentes de silicona, la válvula antirretorno y otros accesorios (excepto la unidad principal) pueden esterilizarse en un esterilizador.
- Precaución para la desinfección de la válvula: **NO** hervir ni esterilizar al vapor durante más de 3 minutos.
- El recipiente está fabricado con material Tritan y **NO** es apto para la esterilización con vapor caliente; en su lugar, se recomienda la esterilización en frío.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	1264W Materno Flow
Tensión de entrada	5V
Potencia nominal	6W
Tensión de la batería	3.7V
Garantía	1 año
Capacidad de la batería	1300mAh / 4.81Wh
Lugar de fabricación	PRC

GARANTÍA – TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra acreditada mediante ticket de caja o factura. En caso de compra con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses no incluye daños derivados del desgaste normal del producto, daños estéticos, accesorios ni materiales de consumo (por ejemplo, baterías, cabezales o componentes sujetos a desgaste). Las baterías tienen una garantía de 6 meses. Términos y condiciones de garantía detallados en

www.nuvitababy.com/warranty

Thank you for purchasing the Nuvita 1264W Wearable Electric Breast Pump. Please read the manual carefully before use and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR THE SAFETY AND HEALTH OF YOU AND YOUR CHILDREN, ALL THE CONTENTS OF THIS PROJECT ARE RELATED TO SAFETY. PLEASE BE SURE TO ABIDE BY THEM.

WARNING

1. Do not use the breast pump in the bath.
2. Please keep this product out of the reach of children or pets.
3. Make sure that the breast pump is not exposed to high temperature or in direct sunlight.
4. If the product is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer or other professionals in maintenance departments or similar departments.
5. Keep all unused parts out of children's reach to avoid being swallowed by children or other dangerous accidents.

DANGER

1. It is forbidden to use or charge near the fire source or in the environment where the temperature exceeds 45 C.
2. It is forbidden to put the host computer and USB charging cable into liquid, such as water, gasoline, drinks, etc.
3. It is forbidden to throw the main unit into the fire or heat it.
4. Do not let children play with the product packaging bag to avoid the danger of suffocation.

NOTICE

- Please charge before using it for the first time.
- When assembling, please be sure to assemble each part according to the assembly instructions.
- Set the suction strength according to personal physique and complete the breast pumping work with comfortable suction.
- Do not tilt or overfill the bottle (do not exceed the maximum scale line).
- Please measure the temperature of the liquid in the feeding bottle to prevent the baby from scalding before using it.
- Please use the breast pump under the guidance of doctors and nurses when you want to use it in the stage of less lactation.
- Please don't over-breastfeed to avoid breast injury.
- Please consult your breast-feeding specialist or doctor if there is any problem or pain.
- The parts of breast pump that come into direct contact with breast milk are personal care items, and mothers should not share them.
- Do not use breast pump during pregnancy, because breast pumping may lead to miscarriage.

- Do not continue to pump milk for more than 5 minutes if no milk is sucked out.
- This product is only for the purposes described in the instruction manual.

INFORMATION

The Nuvita 1264W Materno Flow is designed to support breastfeeding mothers by mimicking a baby's natural nursing rhythm. This wearable electric breast pump is specifically engineered to help moms express breast milk efficiently and comfortably on the go, ensuring a seamless and pain-free pumping experience. It features 9 adjustable intensity levels, NipFit™ functionality, and 3-phase Careflo™ technology.



INDEPENDENT VIBRATION PHASE

The dedicated **Vibration Phase** can be used independently to gently stimulate the breasts, helping to stimulate milk flow and relieve discomfort. It can also be activated during the Stimulation, Extraction, or Anti-stasis phases for additional support.



COMFORTABLE PUMPING WHILE RECLINING

Designed for use while seated with back support (recline up to 130°), making the pumping process more relaxing.



SKIN-FRIENDLY SILICONE BREAST CUP

Equipped with a 24mm soft silicone cup that gently conforms to the breast for a secure and comfortable fit.



CAREFLO™ TECHNOLOGY:

Unlike traditional 2-phase breast pumps, CareFlo™ introduces a third anti-stasis drainage phase alongside the standard stimulation and expression stages. This helps to:

- Promote a more consistent milk supply.
- Prevent clogged ducts and mastitis.
- Relieve breast tension and engorgement.
- Support a smoother, uninterrupted breastfeeding journey.



NIPFIT™ FUNCTION:

Correction of flat or inverted nipples.

This function is designed to help correct flat or inverted nipples and support milk extraction through gentle, progressive stimulation:

- It helps the nipple protrude outward.
- It facilitates the baby's latch on to the breast.
- It supports the initiation and continuation of breastfeeding.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the NipFit™ feature if:

1. You have open sores, cracks, lesions, or active infections on your nipple or areola.
2. You have had recent breast surgery.
3. You have a diagnosed condition of nipple inversion caused by disease or trauma, not congenital. If this is the case, consult your doctor first.
4. You experience sharp pain from the first application. Discontinue use immediately.
5. You have particularly sensitive skin or suffer from local dermatological conditions, such as eczema or psoriasis.
6. You are pregnant. Suctioning may stimulate contractions.



WARNING

The NipFit™ feature is intended for postpartum use only. Do not use during pregnancy.


WARNINGS DURING USE

- Always start at the lowest level, Level 1. Do not increase the intensity until the nipple has gradually adapted, even if the sensation is comfortable.
- Do not exceed 5-10 minutes of continuous use of the NipFit™ feature per session, especially in the first few weeks.
- Do not perform more than 2 correction sessions per day. Excessive use may cause irritation, swelling, or micro-tears to the nipple.
- Discontinue use immediately if you experience sharp pain, abnormal redness, persistent swelling, blisters, or discharge of fluid other than milk.
- This device is not a certified medical device for clinical therapy and does not replace consultation with a midwife, physician, or International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- A Grade 3, severely adherent inverted nipple requires medical evaluation before using any correction device.
- Prolonged, high-intensity use may cause swelling of the areola, temporarily making it more difficult for the baby to latch on. This can have the opposite effect to the desired one.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE:

- Make sure the silicone cup is the correct size, including the 24 mm flange or 20/22 mm reducers, before activating the NipFit™ feature. A cup that is too large can amplify the suction on the areola in an uncontrolled manner.
- Before the session, apply a few drops of breast milk or pure lanolin cream to soften the area.
- During the NipFit™ session, the nipple should be centered in the cup. An incorrect position can cause asymmetric suction and irritation.
- If you do not notice any improvement after 4-6 weeks of proper use, consult a healthcare professional.

PRODUCT COMPONENTS






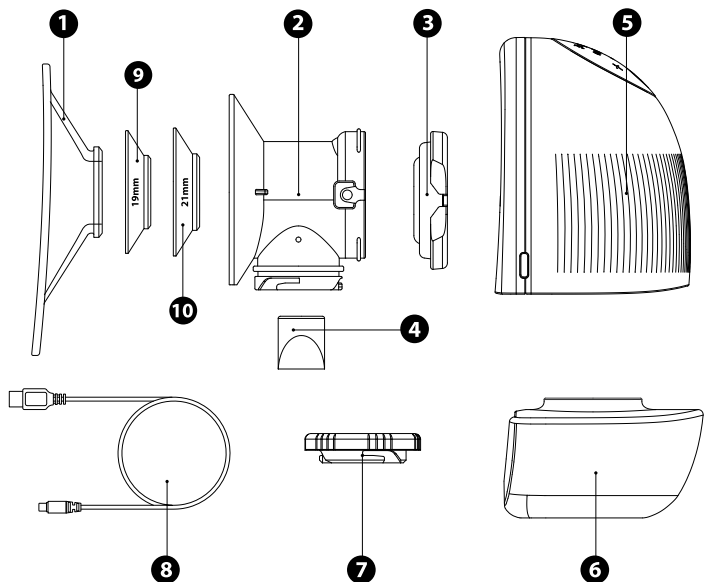


NO.	NAME	MATERIAL	TEMP. RESISTANCE	QUANTITY
1	Silicone cup	Silicone	-20~200°C	1
2	Assembly Unit	PP	-20~120°C	1
3	Anti-backflow Valve	Silicone	-20~200°C	1
4	Non-return Valve	Silicone	-20~200°C	2
5	Main Unit	/	/	1
6	Connector	Tritan	-20~105°C	1
7	Cap	PP	-20~120°C	1
8	USB cable	/	/	1
9	Reducer 19mm	Silicone	-20~120°C	1
10	Reducer 21mm	Silicone	-20~120°C	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Press the anti-backflow valve **(3)** onto the assembly unit **(2)** so that the notches on both sides align with the protrusions on both sides of the assembly unit, and press it flat to ensure a close fit (as shown in figure A).
2. Install the non-return Valve **(4)** on the cylinder below the assembly unit and install it to the end to make it fit closely (as shown in figure B).
3. Align the protrusion on the inner side of the bottle **(6)** neck with the groove below the assembly unit and rotate it clockwise. After installation, the center line of the feeding bottle and the assembly unit is coincident (as shown in Figure C).
4. Press the assembly unit and bottle assembly into the main unit in the direction shown in the figure to ensure that they are installed in place (as shown in Figure D).
5. Align the "▲" on the silicone cup with the "▼" on the main unit, and press the ring at the center of the silicone cup to ensure that it is closely matched with the assembly unit (as shown in Figure E).

NOTE: Please check whether the related accessories are assembled correctly and tightly before breast pumping.



CHARGING METHOD


This product adopts USB charging cable interface, which can supply power in multiple ways.

1. Connect to a computer USB port for use.
2. Connect to the included power adapter (5V2A).
3. Connect to a power bank for use (please use a quality power bank to avoid damaging this product).

The machine automatically recognizes the battery level.

- The display screen of the main unit is provided with a battery power symbol to display the current power. If the power symbol "  " flashes during startup or use, it indicates that the main unit needs to be charged in time.
- After connecting the power supply to charge, the battery power symbol "  " flashes, indicating that the battery is being charged. When the battery is fully charged, the battery power symbol "  " is always on.

NOTE: Please turn off the power and then connect the power adapter to charge.



DESCRIPTION OF PANEL

A1: Power/Phase Switch button: long press to power on and off, short press to switch working phase

A2: Intensity decrease button

A3: Intensity increase button

A2+A3: In stimulation/extraction/anti-stasis phase, press A2+A3 key at the same time to add the extra vibration function in the original working phase, and press it again to cancel the vibration function.

B1: Stimulation indicator


B2: Extraction indicator

B3: Anti-stasis indicator

B4: Vibration indicator

B5: Level and time indicator (When the working phase is switched, the working level is displayed first, and then the working time is displayed).

B1+B3: NipFit™ function activated

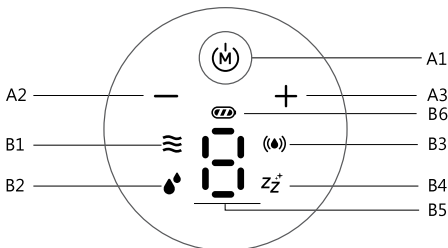

STIMULATION PHASE (LEVEL 1~5): In this phase, the pump generates a relatively fast suction rhythm with low suction power. It is designed to gently stimulate the breast tissue and promote milk ejection by imitating the initial shallow sucking behavior of a baby. It is recommended to use this phase before switching to other phases.

EXTRACTION PHASE (LEVEL 1~9): This phase mimics the deeper and slower suction rhythm of a baby when actively drinking milk. The suction force is higher, and the frequency is slower compared to Stimulation phase. This setting is intended to help extract milk more effectively once the let-down reflex has started.

ANTI-STASIS SUCTION PHASE (LEVEL 1~9): This phase provides a pulsating suction pattern aimed at thoroughly removing remaining milk in the breast after extraction. Regular use may help prevent milk stasis, reduce the risk of clogged ducts, and maintain milk flow




VIBRATION PHASE (LEVEL 1~3): The breast pump uses 13,000 gentle impulses per minute to deeply stimulate the breast, helping to clear the milk ducts and facilitate milk extraction.

NIPFIT™ FUNCTION: To activate the nipple correction function, press the mode button until the (B1) and (B3) icons start flashing. The function has 3 intensity levels.


NOTE: During the stimulation and extraction modes, the vibration operates at a fixed preset intensity and cannot be adjusted. The vibration speed can only be increased or decreased when using the vibration-only mode.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Please wash your hands before use, make sure that the components of the breast pump are thoroughly cleaned and install the breast pump correctly according to the assembly instructions. (Before breast pumping, you can use a warm towel to compress and stimulate your breasts, which is better for breast pumping.)
2. Place the assembled breast pump in the bra and adjust it to a proper angle to make it fit the breast closely (as shown in figure 1).
3. Press and hold the Power/Phase Switch button **(A1)** to start the machine, and the breast pump will automatically enter the stimulation phase (default stimulation level 3). After working for 2 minutes, the product will automatically switch to extraction phase (default extraction level 5) (as shown in figure 2).
4. In the working state, short press the **(A1)** button to switch the working phase cyclically (as shown in figure 3).
5. In the working state, press the **(A2)** and **(A3)** button briefly to adjust the working level of the current phase (as shown in figure 4).



6. In the working state, press the **(A2)** and **(A3)** button at the same time to add "Vibration Phase" in the current working phase, and press it again to cancel the vibration function (as shown in figure 4).
7. Memory function: it can remember the last used stimulation, extraction, anti-stasis and vibration phase working level, which is convenient for one-button operation.
8. In the working state, Press and hold the **(A1)** button to turn off the machine.
9. After breast pumping, take off the bottle and pour the breast milk into a suitable container for storage (as shown in figure 5).



NOTE: Check the milk quantity at any time during the process to ensure that it will not overflow. The breast pump automatically stops working after working in stimulation and extraction phases for 30 minutes. The breast pump automatically stops working after 5 minutes in anti-stasis phase.

CLEANING AND MAINTENANCE

A. BEFORE FIRST USE

Before using the breast pump for the first time, clean and disinfect the relevant components except the main unit and USB cable, and follow the cleaning and disinfection instructions in sections **B** and **C** below.

B. AFTER EACH USE

Clean all parts except the main unit that comes into contact with breast and breast milk. Disassemble the breast pump assembly into separable parts, and rinse all separable parts that come into contact with breast and breast milk in water to remove breast milk residue.

C. DAILY DISINFECTION

- Wash your hands thoroughly.
- Separate all parts that come into contact with breast and breast milk.
- Pour cold water into the pot (the amount of water is appropriate to immerse all parts).
- After the water is boiled, put the parts into boiling water for about 5 minutes, and then gently take them out of the water with a clip.
- Put the sterilised parts on the surface of a clean towel.
- Store them in a dry environment. Do not store them in a dark and humid place when not in use.
- During disinfection, the accessories must not contact the metal wall of the pot (clean gauze can be put between the parts and the pot).
- It is also possible to use a steam steriliser.

PRECAUTIONS FOR CLEANING

- Please disassemble all accessories that come into contact with breast or breast milk. (except main unit)
- After use, please clean the parts immediately to avoid milk residue and bacterial growth.
- When disassembling or assembling, please be sure to assemble/disassemble each accessory according to the assembly instructions.
- When disassembling and cleaning, please be careful about its parts to avoid losing them, which may lead to the failure of assembly or machine operation.
- The Stimulation silicone, anti-backflow silicone and other accessories can be put into the sterilizer for disinfection (except the main unit).
- Precautions for valve disinfection: **DO NOT** boil and steam disinfect for a long time (no more than 3 minutes).
- The container is made of Tritan material and is **NOT** suitable for hot steam sterilization; cold sterilization methods are recommended instead.

PRODUCT SPECIFICATION

Product Name:	1264W Materno Flow
Input Voltage:	5V
Rating Power:	6W
Battery voltage:	3.7V
Warranty:	1 year
Battery Capacity:	1300mAh 4.81Wh
Place of Origin:	PRC

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty against manufacturing defects, starting from the date of purchase as evidenced by a receipt or invoice. If purchased with an invoice, the statutory warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty does not cover damage resulting from normal wear and tear, cosmetic damage, accessories or consumables (e.g. batteries, brush heads or parts subject to wear and tear). Batteries are covered by a 6-month warranty. Full warranty terms and conditions are available at www.nuvitababy.com/warranty

Grazie per aver acquistato il tiralatte elettrico indossabile Nuvita 1264W. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENFANT, TOUTES LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL CONCERNENT LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LES SUIVRE ATTENTIVEMENT.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser le tire-lait pendant le bain.
2. Garder ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
3. Éviter d'exposer le tire-lait à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
4. Si le produit est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié dans un centre de maintenance agréé, afin d'éviter tout danger.
5. Conserver toutes les pièces inutilisées hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent ou ne se blessent.

DANGER

1. Il est interdit d'utiliser ou de charger le produit à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements où la température dépasse 45 °C.
2. Il est interdit d'immerger l'unité principale ou le câble de charge USB dans des liquides comme l'eau, l'essence, des boissons, etc.
3. Il est interdit de jeter l'unité principale dans le feu ou de la chauffer.
4. Ne pas laisser les enfants jouer avec les sacs ou les emballages afin d'éviter les risques d'étouffement.

REMARQUE

- Effectuer une charge complète avant la première utilisation.
- Lors de l'assemblage, s'assurer que chaque pièce est correctement montée selon les instructions fournies.
- Régler l'intensité d'aspiration selon ses besoins physiques pour permettre une extraction du lait confortable.
- Ne pas incliner ou trop remplir le biberon (ne pas dépasser le niveau maximum indiqué).
- Avant l'utilisation, vérifier la température du liquide dans le biberon pour éviter les brûlures.
- Il est recommandé d'utiliser le tire-lait sous la supervision ou selon les recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de santé qualifié.
- Ne pas utiliser excessivement le tire-lait afin d'éviter des lésions au sein.
- En cas de problème ou de douleur, consulter un spécialiste de l'allaitement ou son médecin.
- Les pièces du tire-lait qui entrent en contact direct avec le lait maternel sont des articles personnels et ne doivent pas être partagées avec d'autres personnes.
- Ne pas utiliser le tire-lait pendant la grossesse, car l'extraction du lait pourrait provoquer une fausse couche.

- Ne pas continuer à extraire le lait pendant plus de 5 minutes si aucun lait ne s'écoule.
- Ce produit est destiné exclusivement aux fins décrites dans le manuel d'instructions.

INFORMATIONS

Le Nuvita 1264W Materno Flow est conçu pour accompagner les mamans pendant l'allaitement en imitant le rythme de succion naturel du bébé. Ce tire-lait électrique portable et mains libres est spécifiquement pensé pour vous permettre de tirer votre lait de manière efficace et confortable, même en déplacement, vous garantissant ainsi une expérience pratique et sans douleur. Il dispose de 9 niveaux d'intensité réglables, de la fonction NipFit™ et de la technologie Careflo™ à 3 phases.



MODE VIBRATION INDÉPENDANT

Le mode vibration dédié peut être utilisé indépendamment pour masser délicatement le sein, stimulant ainsi le flux de lait et réduisant l'inconfort. Il peut également être activé pendant les phases de Stimulation, Expression ou Anti-Stase, pour un soutien supplémentaire.



EXPRESSION CONFORTABLE EN POSITION INCLINÉE

Conçu pour une utilisation en position assise avec appui dorsal (inclinaison jusqu'à 130°), il rend le processus d'expression plus relaxant.



COUPELLE EN SILICONE DOUCE POUR LA PEAU

Équipé d'une coupelle en silicone souple de 24 mm qui s'adapte en douceur au sein, pour un ajustement sûr et confortable.



TECHNOLOGIE CAREFLO™ :

Contrairement aux tire-lait traditionnels à 2 phases, le système CareFlo™ intègre une troisième phase de drainage anti-stase en plus des étapes habituelles de stimulation et d'expression. Cela permet de :

- Favoriser une production de lait plus régulière.
- Prévenir les engorgements et les mastites.
- Soulager la tension mammaire et la sensation de seins lourds.
- Assurer un allaitement plus serein et sans interruption.



FONCTION NIPFIT™ :

Correction des mamelons plats ou ombiliqués.

Cette fonction est conçue pour corriger les mamelons plats ou ombiliqués et favoriser l'extraction du lait grâce à une stimulation douce et progressive :

- Elle aide le mamelon à ressortir.
- Elle facilite la prise du sein par le bébé.
- Elle soutient l'initiation et la poursuite de l'allaitement.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la fonction NipFit™ si :

1. Vous avez des plaies ouvertes, des crevasses, des lésions ou une infection active au niveau du mamelon ou de l'aréole.
2. Vous avez subi une intervention chirurgicale mammaire récemment.
3. Vous souffrez d'une inversion du mamelon diagnostiquée, d'origine pathologique ou traumatique, et non congénitale. Dans ce cas, consultez d'abord votre médecin.
4. Vous ressentez une douleur aiguë dès la première application. Arrêtez immédiatement l'utilisation.
5. Vous avez la peau particulièrement sensible ou souffrez d'affections dermatologiques localisées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.
6. Vous êtes enceinte. L'aspiration peut provoquer des contractions.



AVERTISSEMENT

Le dispositif NipFit™ est conçu exclusivement pour un usage post-partum. Ne pas utiliser pendant la grossesse.


AVERTISSEMENTS LORS DE L'UTILISATION

- Commencez toujours par le niveau le plus bas, le niveau 1. N'augmentez pas l'intensité tant que le mamelon ne s'est pas progressivement adapté, même si la sensation est agréable.
- N'utilisez pas la fonction NipFit™ pendant plus de 5 à 10 minutes d'affilée par séance, surtout pendant les premières semaines.
- Ne faites pas plus de 2 séances de correction par jour. Une utilisation excessive peut provoquer une irritation, un gonflement ou des micro-déchirures du mamelon.
- Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur aiguë, de rougeur anormale, de gonflement persistant, d'ampoules ou d'écoulement d'un liquide autre que du lait.
- Cet appareil n'est pas un dispositif médical certifié pour un usage clinique et ne remplace pas la consultation d'une sage-femme, d'un médecin ou d'une consultante en lactation certifiée IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant).
- Un mamelon ombiliqué de grade 3 (mamelon adhérent sévère) nécessite une évaluation médicale avant l'utilisation de tout appareil de correction.
- Une utilisation prolongée et intense peut provoquer un gonflement de l'aréole, rendant temporairement la prise du sein plus difficile pour le bébé. Cela peut avoir l'effet inverse de celui recherché.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:

- Avant d'activer la fonction NipFit™, assurez-vous que la ventouse en silicone est de la bonne taille, y compris la collerette de 24 mm ou les réducteurs de 20/22 mm. Une ventouse trop grande peut amplifier la succion sur l'aréole de manière incontrôlée.
- Avant la séance, appliquez quelques gouttes de lait maternel ou de crème à la lanoline pure pour assouplir la zone.
- Pendant la séance NipFit™, le mamelon doit être centré dans la ventouse. Un mauvais positionnement peut entraîner une succion asymétrique et des irritations.
- Si vous ne constatez aucune amélioration après 4 à 6 semaines d'utilisation correcte, consultez un professionnel de santé.

COMPOSANTS DU PRODUIT






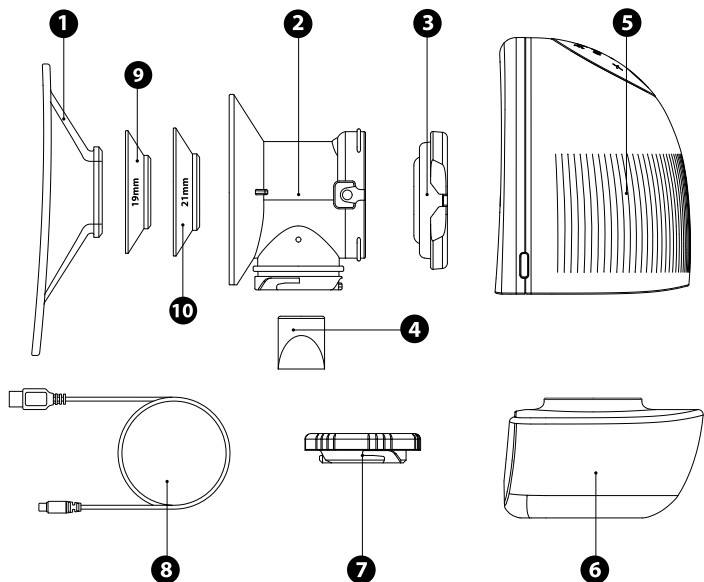


N°	NOM	MATÉRIAU	TEMP. RÉSISTANCE	QUANTITÉ
1	Coupelle en silicone	Silicone	-20~200°C	1
2	Corps d'assemblage	PP	-20~120°C	1
3	Valve anti-retour	Silicone	-20~200°C	1
4	Clapet anti-retour	Silicone	-20~200°C	2
5	Unité principale	/	/	1
6	Récipient	Tritan	-20~105°C	1
7	Couvercle	PP	-20~120°C	1
8	Câble USB	/	/	1
9	Réductrice 19mm	Silicone	-20~120°C	1
10	Réductrice 21mm	Silicone	-20~120°C	1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérer la valve anti-reflux (3) sur le corps d'assemblage (2) de manière à ce que les encoches de chaque côté soient alignées avec les saillies sur les côtés, puis appuyer pour s'assurer qu'elle adhère parfaitement (comme montré sur la figure A).
2. Installer la valve de non-retour (4) dans le cylindre sous le corps d'assemblage et l'enfoncer jusqu'au fond pour garantir une étanchéité parfaite (comme montré sur la figure B).
3. Aligner la saillie interne du raccord (6) avec la rainure sous le corps d'assemblage et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois installé, l'axe central du récipient et celui du corps d'assemblage doivent coïncider (comme montré sur la figure C).
4. Insérer le corps d'assemblage et le récipient dans l'unité principale dans la direction indiquée sur l'image, en s'assurant qu'ils soient bien fixés (comme montré sur la figure D).
5. Aligner le symbole "▲" sur le silicone avec le symbole "▼" sur l'unité principale, en appuyant au centre du silicone pour assurer un couplage parfait avec le corps d'assemblage (comme montré sur la figure E).

REMARQUE : Avant de commencer l'expression du lait, vérifiez que tous les accessoires sont correctement assemblés et bien fixés.




MÉTHODE DE CHARGE

Ce produit utilise une interface USB pour le câble de recharge, permettant plusieurs modes d'alimentation :

1. Connexion à un port USB de l'ordinateur.
2. Connexion avec l'adaptateur fourni (5V2A).
3. Connexion à une batterie externe (utiliser une batterie de bonne qualité pour éviter d'endommager le produit).

L'appareil reconnaît automatiquement le niveau de la batterie.



- L'écran de l'unité principale affiche une icône de batterie pour indiquer l'état de charge actuel. Si le "🔋" clignote pendant l'allumage ou l'utilisation, cela signifie que l'unité principale doit être rechargée rapidement.
- Une fois connecté à l'alimentation, le "🔋" clignote pour indiquer qu'il est en cours de charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le symbole reste fixe. "🔋"

REMARQUE : Éteindre l'appareil avant de le connecter à l'alimentation pour la recharge.

DESCRIPTION DU PANNEAU

A1 : Bouton Marche/Changement de mode
Appuyer longuement pour allumer ou éteindre, appuyer brièvement pour changer de mode de fonctionnement.

A2 : Bouton pour diminuer l'intensité

A3 : Bouton pour augmenter l'intensité

A2+A3 : En modes stimulation/expression/anti-stase, appuyer simultanément sur les deux boutons pour ajouter la fonction de vibration supplémentaire au mode actif. Appuyer de nouveau pour désactiver la vibration.

B1 : Indicateur du mode de stimulation


B2 : Indicateur du mode d'expression

B3 : Indicateur du mode anti-stase

B4 : Indicateur de vibration

B5 : Indicateur de niveau et de temps (lorsqu'un mode est changé, l'écran affiche d'abord le mode sélectionné, puis le temps de fonctionnement).

B1+B3 : Fonction NipFit™ activée



MODE STIMULATION (NIVEAU 1~5) : Dans ce mode, le tire-lait génère un rythme de succion relativement rapide avec une puissance d'aspiration faible. Il est conçu pour stimuler délicatement les tissus du sein et favoriser l'extraction du lait en imitant le comportement de succion initial superficiel d'un nouveau-né. Il est recommandé d'utiliser ce mode en premier avant de passer aux autres.

MODE EXPRESSION (NIVEAU 1~9) : Ce mode imite le rythme de succion plus profond et lent d'un nouveau-né pendant l'allaitement actif. La force d'aspiration est plus élevée et la fréquence plus lente que dans le mode stimulation. Ce réglage est conçu pour aider à exprimer le lait de manière plus efficace une fois l'écoulement amorcé.

MODE ANTI-STASE (NIVEAU 1~9) : Ce mode fonctionne par impulsions ciblées pour éliminer avec précision le lait résiduel dans le sein après l'expression. Une utilisation régulière peut aider à prévenir la stase lactée, à réduire le risque de canaux obstrués et à maintenir un bon débit de lait.



MODE VIBRATION (NIVEAU 1~3) : Le tire-lait utilise 13 000 impulsions délicates par minute pour stimuler le sein en profondeur, contribuant ainsi à libérer les canaux lactifères et à faciliter l'écoulement du lait.

FONCTION NIPFIT™ : Pour activer la fonction de correction des mamelons, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que les icônes (B1) et (B3) clignotent. Cette fonction propose 3 niveaux d'intensité.


REMARQUE : En modes stimulation et extraction, la vibration fonctionne à une intensité prédéfinie et fixe. La vitesse de vibration ne peut être augmentée ou diminuée qu'en mode vibration seule.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Se laver soigneusement les mains avant l'utilisation. S'assurer que tous les composants du tire-lait ont été correctement nettoyés et assemblés selon les instructions. (Avant de commencer l'expression, il est recommandé d'utiliser une serviette chaude pour comprimer et masser le sein afin de faciliter l'écoulement du lait.)
2. Placer le tire-lait assemblé à l'intérieur du soutien-gorge, en ajustant l'angle de manière à ce qu'il adhère parfaitement au sein (comme illustré à la figure 1).
3. Maintenez le bouton Marche/Changement de mode (A1) enfoncé pour allumer l'appareil, qui démarrera automatiquement en mode stimulation (niveau prédéfini : 3). Après 2 minutes de fonctionnement, l'appareil passera automatiquement en mode expression (niveau prédéfini : 5) (voir figure 2).
4. Pendant le fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton (A1) pour passer d'un mode à l'autre (voir figure 3).
5. Pendant le fonctionnement, appuyez brièvement sur les boutons (A2) et (A3) pour régler le niveau d'intensité du mode actif (voir figure 4).



6. Pendant le fonctionnement, appuyez simultanément sur les boutons (A2) et (A3) pour activer le mode vibration en complément du mode actif. Appuyez de nouveau pour désactiver la vibration (voir figure 4).
7. Mémoire de fonctionnement : l'appareil mémorise le dernier niveau utilisé pour chaque mode (stimulation, expression, anti-stase et vibration), ce qui facilite l'utilisation avec un seul bouton.
8. Pendant le fonctionnement, maintenez le bouton (A1) enfoncé pour éteindre l'appareil.
9. Une fois l'expression du lait terminée, retirez le biberon et transférez le lait maternel dans un récipient adapté à la conservation (voir figure 5).



REMARQUE : Vérifiez à tout moment la quantité de lait exprimé pour éviter les débordements. L'appareil s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'utilisation continue en mode stimulation ou expression, et après 5 minutes en mode anti-stase.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser le tire-lait pour la première fois, nettoyez et désinfectez soigneusement toutes les pièces (à l'exception de l'unité principale et du câble USB), en suivant les instructions des sections B et C ci-dessous.

B. APRÈS CHAQUE UTILISATION

Nettoyez soigneusement toutes les parties (sauf l'unité principale) qui sont en contact direct avec le sein et le lait maternel.

Démontez le tire-lait en pièces séparées et rincez chaque élément à l'eau tiède pour éliminer les résidus.

C. DÉSINFECTION QUOTIDIENNE

- Lavez-vous soigneusement les mains.
- Séparez toutes les parties en contact avec le sein et le lait maternel.
- Versez de l'eau froide dans un récipient (en quantité suffisante pour immerger complètement les pièces).
- Une fois l'eau portée à ébullition, plongez les pièces pendant environ 5 minutes, puis retirez-les délicatement à l'aide d'une pince.
- Déposez les pièces stérilisées sur une serviette propre.
- Conservez les pièces dans un endroit sec. Évitez de les stocker dans des endroits sombres et humides lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Pendant la stérilisation, les accessoires ne doivent pas entrer en contact direct avec les parois métalliques du récipient (il est conseillé d'utiliser une gaze propre comme séparateur entre les pièces et le récipient).
- Vous pouvez également utiliser un stérilisateur à vapeur.

PRÉCAUTIONS POUR LE NETTOYAGE

- Toujours démonter tous les accessoires en contact avec le sein ou le lait maternel (sauf l'unité principale).
- Après chaque utilisation, nettoyez immédiatement les pièces pour éviter les résidus de lait et la prolifération des bactéries.
- Lors du montage ou du démontage, veillez à suivre les instructions pour chaque composant.
- Lors du démontage et du nettoyage, faites attention à ne pas perdre de pièces pour éviter les dysfonctionnements pendant l'assemblage ou l'utilisation du produit.
- Le silicone de stimulation, la valve anti-retour et les autres accessoires (sauf l'unité principale) peuvent être stérilisés dans un stérilisateur.
- Précautions pour la désinfection de la valve : **NE PAS** faire bouillir ou stériliser à la vapeur plus de 3 minutes.
- Le récipient est fabriqué en Tritan et ne convient **PAS** à la stérilisation à la vapeur chaude ; les méthodes de stérilisation à froid sont recommandées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit	1264W Materno Flow
Tension d'entrée	5V
Puissance nominale	6W
Tension de la batterie	3.7V
Garantie	1 an
Capacité de la batterie	1300mAh 4.81Wh
Lieu de fabrication	Chine

GARANTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat telle qu'attestée par un ticket de caisse ou une facture. En cas d'achat sur facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale, les dommages esthétiques, les accessoires ou les consommables (par exemple, les piles, les têtes de brosse ou les pièces soumises à l'usure). Les batteries sont couvertes par une garantie de 6 mois. Les conditions générales de garantie complètes sont disponibles sur www.nuvitababy.com/warranty

Vielen Dank für den Kauf der tragbaren elektrischen Milchpumpe Nuvita 1264W. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zur späteren Einsichtnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ZUR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT VON IHNEN UND IHREM KIND: ALLE IN DIESEM HANDBUCH AUFGEFÜHRTE HINWEISE BETREFFEN DIE SICHERHEIT. BITTE IMMER BEACHTEN.

ACHTUNG

1. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während des Badens.
2. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
3. Vermeiden Sie es, die Milchpumpe hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auszusetzen.
4. Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller oder qualifiziertem Personal in einem autorisierten Servicezentrum ersetzt werden.
5. Halten Sie alle unbenutzten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.

GEFAHR

1. Es ist verboten, das Gerät in der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit Temperaturen über 45 °C zu verwenden oder aufzuladen.
2. Es ist verboten, die Haupteinheit oder das USB-Ladekabel in Flüssigkeiten wie Wasser, Benzin, Getränke usw. einzutauchen.
3. Es ist verboten, die Haupteinheit ins Feuer zu werfen oder zu erhitzen.
4. Lassen Sie Kinder nicht mit Beuteln oder Verpackungen spielen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.

HINWEIS

- Führen Sie vor der ersten Benutzung eine vollständige Aufladung durch.
- Stellen Sie beim Zusammenbau sicher, dass alle Teile gemäß den mitgelieferten Anweisungen korrekt montiert sind.
- Passen Sie die Saugstärke je nach Ihren körperlichen Bedürfnissen an, um das Abpumpen angenehm zu gestalten.
- Neigen oder überfüllen Sie die Flasche nicht (nicht über die angegebene Maximalmarkierung hinaus).
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Temperatur der Flüssigkeit in der Flasche, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, die Milchpumpe unter Aufsicht und nach Anweisung von medizinischem Fachpersonal oder einer Hebamme zu verwenden. Non utilizzare eccessivamente il tirallatte per evitare lesioni al seno.

- Die Teile der Milchpumpe, die mit der Muttermilch in direkten Kontakt kommen, sind persönliche Gegenstände und sollten von Müttern nicht mit anderen Personen geteilt werden.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während der Schwangerschaft, da das Abpumpen von Milch eine Fehlgeburt auslösen kann.
- Pumpen Sie nicht länger als 5 Minuten ab, wenn keine Milch fließt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke bestimmt.

INFORMATIONEN

Der Nuvita 1264W Materno Flow wurde entwickelt, um stillende Mütter optimal zu unterstützen, indem er den natürlichen Saugrhythmus des Babys imitiert. Diese tragbare elektrische Milchpumpe wurde speziell für das effiziente und komfortable Abpumpen von Muttermilch von unterwegs entwickelt – für ein schmerzfreies und angenehmes Anwendungserlebnis. Sie verfügt über 9 einstellbare Intensitätsstufen, die NipFit™-Funktion sowie die 3-Phasen-Careflo™-Technologie.



UNABHÄNGIGER VIBRATIONSMODUS

Der spezielle **Vibrationsmodus** kann unabhängig verwendet werden, um die Brust sanft zu massieren, den Milchfluss zu stimulieren und Beschwerden zu lindern. Er kann auch während der Modi Stimulation, Abpumpen oder Anti-Stau aktiviert werden, um zusätzliche Unterstützung zu bieten.



KOMFORTABLES ABPUMPEN IN ZURÜCKGELEHNER POSITION

Entwickelt für den Einsatz im Sitzen mit Rückenstütze (Neigung bis zu 130°), um den Abpumpvorgang entspannter zu gestalten.



HAUTFREUNDLICHER SILIKONTRICHTER

Ausgestattet mit einem weichen 24-mm-Silikontrichter, der sich sanft an die Brust anpasst und eine sichere und komfortable Passform bietet.



CAREFLO™-TECHNOLOGIE:

Im Gegensatz zu herkömmlichen 2-Phasen-Milchpumpen bietet CareFlo™ neben der üblichen Stimulations- und Abpumpphase eine dritte Phase:

- Das entlastende Entleeren zur Vermeidung von Milchstau.
- Dies hilft: Eine gleichmäßigere Milchbildung zu fördern.
- Milchstau und Brustdrüsenentzündungen (Mastitis) vorzubeugen. Spannungsgefühle und schmerzhaft pralle Brüste zu entlasten.
- Eine harmonische, ununterbrochene Stillzeit zu unterstützen.



NIPFIT™-FUNKTION:

Korrektur von Flach- oder Hohlwarzen.

Diese Funktion dient der Korrektur von Flach- oder Hohlwarzen und unterstützt die Milchbildung durch sanfte, progressive Stimulation:

- Sie hilft der Brustwarze, sich nach außen zu wölben.
- Sie erleichtert dem Baby das Anlegen an die Brust.
- Sie unterstützt den Beginn und die Fortsetzung des Stillens.

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie die NipFit™-Funktion nicht, wenn:

1. Sie offene Wunden, Risse, Läsionen oder aktive Infektionen an Ihrer Brustwarze oder Ihrem Warzenhof haben.
2. Sie sich kürzlich einer Brustoperation unterzogen haben.
3. Bei Ihnen eine diagnostizierte, durch Krankheit oder Trauma bedingte, nicht angeborene Brustwarzenretraktion vorliegt. Konsultieren Sie in diesem Fall bitte zuerst Ihren Arzt/Ihre Ärztin.
4. Sie bei der ersten Anwendung starke Schmerzen verspüren. Brechen Sie die Anwendung sofort ab.
5. Sie besonders empfindliche Haut haben oder an lokalen Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Psoriasis leiden.
6. Sie schwanger sind. Das Saugen kann Wehen auslösen.



WARNUNG

Die NipFit™-Funktion ist ausschließlich für die Anwendung nach der Geburt bestimmt. Nicht während der Schwangerschaft anwenden.


WARNHINWEISE WÄHREND DER VERWENDUNG

- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe, Stufe 1. Erhöhen Sie die Intensität erst, wenn sich die Brustwarze allmählich daran gewöhnt hat, auch wenn sich das Gefühl angenehm anfühlt.
- Verwenden Sie die NipFit™-Funktion nicht länger als 5–10 Minuten pro Anwendung, insbesondere in den ersten Wochen.
- Führen Sie nicht mehr als zwei Korrekturanwendungen pro Tag durch. Übermäßige Anwendung kann zu Reizungen, Schwellungen oder Mikroverletzungen der Brustwarze führen.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie starke Schmerzen, ungewöhnliche Rötungen, anhaltende Schwellungen, Blasenbildung oder den Austritt von Flüssigkeiten außer Milch bemerken.
- Dieses Gerät ist kein zugelassenes Medizinprodukt für die klinische Therapie und ersetzt nicht die Beratung durch eine Hebamme, einen Arzt oder eine international zertifizierte Stillberaterin (IBCLC).
- Bei einer stark verklebten Hohlwarze (Grad 3) ist vor der Anwendung eines Korrekturgeräts eine ärztliche Untersuchung erforderlich.
- Längere, intensive Anwendung kann zu Schwellungen des Warzenhofs führen und das Anlegen für das Baby vorübergehend erschweren. Dies kann den gegenteiligen Effekt zum gewünschten Ergebnis haben.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG:

- Stellen Sie vor der Aktivierung der NipFit™-Funktion sicher, dass die Silikon-Brustwarze die richtige Größe hat, einschließlich des 24-mm-Flansches oder der 20/22-mm-Reduzierstücke. Eine zu große Brustwarze kann den Sog auf die Brustwarze unkontrolliert verstärken.
- Tragen Sie vor der Anwendung einige Tropfen Muttermilch oder reine Lanolincreme auf, um die Haut zu beruhigen.
- Während der NipFit™-Anwendung sollte die Brustwarze mittig in der Brustwarze positioniert sein.
- Eine falsche Position kann zu ungleichmäßigem Sog und Hautreizungen führen.
- Wenn Sie nach 4–6 Wochen korrekter Anwendung keine Besserung feststellen, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachkraft.

PRODUKTKOMPONENTEN






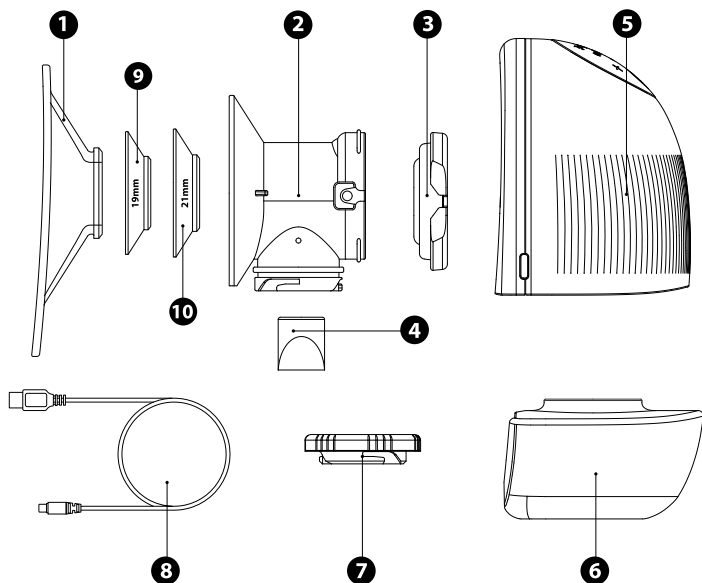


NR.	NAME	MATERIAL	TEMP.-BESTÄNDIGKEIT	MENGE
1	Silikontrichter	Silikon	-20~200°C	1
2	Montagekörper	PP	-20~120°C	1
3	Anti-Rückflussventil	Silikon	-20~200°C	1
4	Rückschlagventil	Silikon	-20~200°C	2
5	Haupteinheit	/	/	1
6	Behälter	Tritan	-20~105°C	1
7	Deckel	PP	-20~120°C	1
8	USB-Kabel	/	/	1
9	Reduzierstück 19mm	Silikon	-20~120°C	1
10	Reduzierstück 21mm	Silikon	-20~120°C	1

MONTAGEANLEITUNG

1. Setzen Sie das Anti-Rückflussventil **(3)** in den Montagekörper **(2)** ein, sodass die Einkerbungen auf beiden Seiten mit den Vorsprüngen ausgerichtet sind, und drücken Sie es fest, damit es sicher sitzt (wie in Abbildung A gezeigt).
2. Setzen Sie das Rückschlagventil **(4)** in den Zylinder unter dem Montagekörper ein und drücken Sie es vollständig hinein, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten (wie in Abbildung B gezeigt).
3. Richten Sie die innere Nase des Verbindungsteils **(6)** an der Nut unter dem Montagekörper aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Nach dem Einsetzen müssen die Mittelachsen des Behälters und des Montagekörpers übereinstimmen (wie in Abbildung C gezeigt).
4. Setzen Sie den Montagekörper und den Behälter in die Haupteinheit in der angegebenen Richtung ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen (wie in Abbildung D gezeigt).
5. Richten Sie das Symbol "▲" auf dem Silikon mit dem Symbol "▼" auf der Haupteinheit aus und drücken Sie auf die Mitte des Silikonteils, um sicherzustellen, dass es perfekt mit dem Montagekörper verbunden ist (wie in Abbildung E gezeigt).

HINWEIS: Vor Beginn des Abpumpens überprüfen Sie bitte, ob alle Zubehörteile korrekt montiert und sicher befestigt sind.



LADEMETHODE


Dieses Produkt verwendet eine USB-Schnittstelle für das Ladekabel und unterstützt mehrere Stromversorgungsmodi:

1. Anschluss an einen USB-Port des Computers.
2. Anschluss mit dem mitgelieferten Adapter (5V 2A).
3. Anschluss an eine Powerbank (verwenden Sie eine hochwertige Powerbank, um Schäden am Gerät zu vermeiden).

Das Gerät erkennt den Batteriestand automatisch.

- Das Display der Haupteinheit zeigt ein Batteriesymbol an, um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen. Wenn das Batteriesymbol "  " blinkt, während das Gerät eingeschaltet oder in Gebrauch ist, bedeutet dies, dass die Haupteinheit bald aufgeladen werden muss.
- Nach dem Anschluss des Geräts an die Stromquelle blinkt das Batteriesymbol "  " um anzuzeigen, dass der Akku lädt. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das Batteriesymbol dauerhaft. "  " "

HINWEIS: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.



BEDIENFELD-BESCHREIBUNG

A1: Ein-/Aus-Taste / Moduswahl: Lange drücken zum Ein- oder Ausschalten, kurz drücken zum Wechseln des Modus.

A2: Taste zur Verringerung der Intensität

A3: Taste zur Erhöhung der Intensität

A2 + A3: In den Modi Stimulation / Abpumpen / Anti-Stau: Beide Tasten gleichzeitig drücken, um die Vibrationsfunktion dem aktuellen Modus hinzuzufügen. Nochmals drücken, um die Vibration zu deaktivieren.

B1: Anzeige für Stimulation


B2: Anzeige für Abpumpen

B3: Anzeige für Anti-Stau

B4: Anzeige für Vibration

B5: Anzeige für Intensitätsstufe und Zeit (Wenn der Modus geändert wird, zeigt das Display zuerst den Modus und dann die aktuelle Betriebszeit an.)

B1+B3: NipFit™-Funktion aktiviert

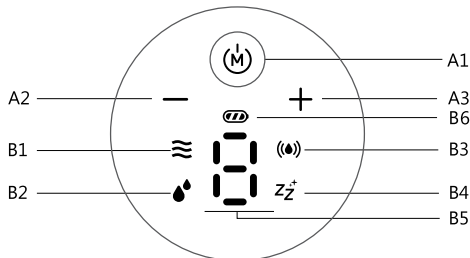

STIMULATIONSMODUS (STUFE 1~5): In diesem Modus erzeugt die Milchpumpe einen relativ schnellen Saugzyklus mit geringer Saugkraft. Er ist dafür konzipiert, das Brustgewebe sanft zu stimulieren und den Milchfluss zu fördern, indem er das Saugverhalten eines Neugeborenen in der Anfangsphase nachahmt. Es wird empfohlen, diesen Modus vor dem Wechsel zu anderen Modi zu verwenden.

ABPUMPMODUS (STUFE 1~9): Dieser Modus imitiert das tiefere und langsamere Saugen eines aktiv stillenden Neugeborenen. Die Saugkraft ist stärker und die Frequenz langsamer als im Stimulationsmodus. Diese Einstellung ist dafür gedacht, die Milch nach Beginn der Entleerung effektiver abzupumpen.

ANTI-STAU-MODUS (STUFE 1~9): Dieser Modus arbeitet pulsierend und ist speziell darauf ausgerichtet, verbleibende Milchreste in der Brust nach dem Abpumpen gründlich zu entfernen. Regelmäßige Anwendung kann helfen, Milchstau zu vermeiden, das Risiko verstopfter Milchgänge zu verringern und den Milchfluss aufrechtzuerhalten.




VIBRATIONSMODUS (STUFE 1~3): Die Milchpumpe verwendet 13.000 sanfte Impulse pro Minute, um das Brustgewebe tiefgehend zu stimulieren. Dadurch wird die Öffnung der Milchgänge gefördert und der Milchfluss erleichtert.

NIPFIT™-FUNKTION: Um die Brustwarzenkorrekturfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Modustaste, bis die Symbole (B1) und (B3) blinken. Die Funktion verfügt über 3 Intensitätsstufen.


HINWEIS: Im Stimulations- und Extraktionsmodus arbeitet die Vibration mit einer festen, voreingestellten Intensität, die nicht angepasst werden kann. Die Vibrationsgeschwindigkeit kann nur im reinen Vibrationsmodus erhöht oder verringert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich vor dem Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Milchpumpe ordnungsgemäß gereinigt und gemäß den Anweisungen korrekt montiert wurden. (Vor dem Abpumpen empfiehlt es sich, ein warmes Handtuch zu verwenden, um die Brust zu massieren und das Abpumpen zu erleichtern.)
2. Platzieren Sie die montierte Milchpumpe im BH, und passen Sie den Winkel so an, dass sie vollständig an der Brust anliegt (wie in Abbildung 1 dargestellt).
3. Halten Sie die Ein-/Moduswahltaste (A1) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es startet automatisch im Stimulationsmodus (voreingestellte Stufe: 3). Nach 2 Minuten wechselt das Gerät automatisch in den Abpumpmodus (voreingestellte Stufe: 5) (siehe Abbildung 2).
4. Während des Betriebs drücken Sie kurz die Taste (A1), um zwischen den verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln (siehe Abbildung 3).



5. Drücken Sie während des Betriebs kurz die Tasten (A2) und (A3), um die Intensität des aktuellen Modus zu regulieren (siehe Abbildung 4).
6. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten (A2) und (A3), um den „Vibrationsmodus“ zum aktuellen Betriebsmodus hinzuzufügen. Drücken Sie erneut, um die Vibrationsfunktion zu deaktivieren (siehe Abbildung 4).



7. Speicherfunktion: Das Gerät merkt sich die zuletzt verwendete Intensitätsstufe für jeden Modus (Stimulation, Abpumpen, Anti-Stau und Vibration), was die Bedienung mit nur einer Taste erleichtert.
8. Halten Sie während des Betriebs die Taste (A1) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



9. Nach dem Abpumpen entfernen Sie die Flasche und füllen die Muttermilch in einen geeigneten Aufbewahrungsbehälter um (siehe Abbildung 5).

HINWEIS: Überprüfen Sie regelmäßig die Milchmenge, um ein Überlaufen zu vermeiden. Die Milchpumpe schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ununterbrochenem Betrieb in den Modi „Stimulation“ und „Abpumpen“ ab und nach 5 Minuten im Modus „Anti-Stau“.

REINIGUNG UND WARTUNG

A. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Vor der ersten Verwendung der Milchpumpe müssen alle Teile (außer der Haupteinheit und dem USB-Kabel) gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion in den nachfolgenden Abschnitten B und C.

B. NACH JEDEM GEBRAUCH

Reinigen Sie alle Teile gründlich (außer der Haupteinheit), die mit der Brust oder Muttermilch in Kontakt kommen. Zerlegen Sie die Milchpumpe in ihre Einzelteile und spülen Sie diese mit lauwarmem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen.

C. TÄGLICHE DESINFEKTION

- Waschen Sie sich gründlich die Hände.
- Trennen Sie alle Teile, die mit Brust oder Muttermilch in Kontakt kommen.
- Gießen Sie kaltes Wasser in einen Behälter (in ausreichender Menge, um alle Teile vollständig zu bedecken).
- Nachdem das Wasser zum Kochen gebracht wurde, die Teile für ca. 5 Minuten darin eintauchen und anschließend vorsichtig mit einer Zange herausnehmen.
- Die sterilisierten Teile auf ein sauberes Handtuch legen.
- Die Teile an einem trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie es, sie in dunklen und feuchten Umgebungen aufzubewahren, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Während der Desinfektion dürfen die Zubehöerteile nicht direkt mit den Metallwänden des Behälters in Kontakt kommen (es wird empfohlen, ein sauberes Mulltuch als Trennung zwischen den Teilen und dem Behälter zu verwenden).
- Alternativ kann auch ein Dampfsterilisator verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER REINIGUNG

- Zerlegen Sie immer alle Zubehörteile, die mit der Brust oder Muttermilch in Kontakt kommen (außer der Haupteinheit).
- Reinigen Sie nach jedem Gebrauch sofort die Teile, um Milchreste und Bakterienvermehrung zu vermeiden.
- Achten Sie beim Zusammen- und Auseinanderbauen darauf, die Anweisungen für jedes Bauteil zu befolgen.
- Achten Sie beim Zerlegen und Reinigen darauf, keine Teile zu verlieren, um Fehlfunktionen beim Zusammenbau oder Gebrauch zu vermeiden.
- Das Stimulationssilikon, das Anti-Rückfluss-Ventil und andere Zubehörteile (außer der Haupteinheit) können im Sterilisator sterilisiert werden.
- Vorsichtsmaßnahmen für die Ventil-Desinfektion: **NICHT** länger als 3 Minuten kochen oder dampfsterilisieren.
- Der Behälter besteht aus Tritan-Material und ist **NICHT** für die Heißdampfsterilisation geeignet; stattdessen werden Kaltsterilisationsverfahren empfohlen.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Produktname	1264W Materno Flow
Eingangsspannung	5V
Nennleistung	6W
Batteriespannung	3,7V
Garantie	1 Jahr
Batteriekapazität	1300mAh 4,81Wh
Herstellungsort	PRC

GARANTIE – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend mit dem Kaufdatum, das durch einen Kaufbeleg oder eine Rechnung nachgewiesen wird. Bei Kauf mit Rechnung verkürzt sich die gesetzliche Gewährleistungsfrist auf 12 Monate. Die 24-monatige Garantie deckt keine Schäden ab, die auf normale Abnutzung, kosmetische Mängel, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Akkus, Bürstenköpfe oder Verschleißteile) zurückzuführen sind. Für Akkus gilt eine Garantie von 6 Monaten. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.nuvitababy.com/warranty

Grazie per aver acquistato il tiralatte elettrico indossabile Nuvita 1264W. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

PARA A SUA SEGURANÇA E A DO SEU BEBÊ, TODAS AS INDICAÇÕES DESTE MANUAL SÃO RELATIVAS À SEGURANÇA. CERTIFIQUE-SE DE SEGUIR TODAS ELAS.

ATENÇÃO

1. Não utilize o extrator de leite durante o banho.
2. Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais de estimação.
3. Evite expor o extrator de leite a altas temperaturas ou à luz solar direta.
4. Se o produto estiver danificado, substitua-o para evitar riscos, utilizando um produto novo ou leve-o a um centro de assistência autorizado ou a pessoal qualificado.
5. Mantenha todas as peças não utilizadas fora do alcance das crianças para evitar ingestão acidental ou acidentes.

PERIGO

1. É proibido utilizar ou carregar o produto perto de fontes de calor ou em ambientes onde a temperatura exceda 45°C.
2. É proibido imergir a unidade principal ou o cabo de carregamento USB em líquidos, como água, gasolina, bebidas etc.
3. É proibido jogar a unidade principal no fogo ou aquecê-la.
4. Não permita que crianças brinquem com sacos plásticos ou embalagens para evitar risco de sufocamento.

AVISO

- Realize uma carga completa antes do primeiro uso.
- Durante a montagem, certifique-se de que todas as peças estejam corretamente instaladas conforme as instruções.
- Ajuste a intensidade da sucção de acordo com suas necessidades físicas, para garantir a extração confortável do leite.
- Não incline ou encha excessivamente a garrafa (não ultrapasse o nível máximo indicado).
- Antes do uso, verifique a temperatura do líquido dentro da garrafa para evitar queimaduras.
- Recomenda-se utilizar o extrator de leite sob supervisão e orientação de um profissional de saúde qualificado.
- Não utilize o extrator de leite em excesso para evitar lesões nos seios.
- Consulte um especialista em amamentação ou seu médico em caso de problemas ou dores.
- As partes do extrator de leite que entram em contato direto com o leite materno são itens pessoais e as mães não devem compartilhá-los com outras pessoas.

- Não utilize o extrator de leite durante a gravidez, pois a extração do leite pode causar aborto espontâneo.
- Não continue a extrair leite por mais de 5 minutos se não houver fluxo de leite.
- Este produto é destinado exclusivamente aos fins descritos no manual de instruções.

INFORMAÇÕES

O Nuvita 1264W Materno Flow foi desenvolvido para apoiar as mães durante a amamentação, imitando o ritmo natural de sucção do bebê. Esta bomba tira-leite elétrica e usável (mãos livres) foi pensada especificamente para extrair o leite materno de forma eficiente e confortável mesmo fora de casa, garantindo uma experiência prática e sem dor. Conta com 9 níveis de intensidade reguláveis, a função NipFit™ e a tecnologia CareFlo™ de 3 fases.



MODO DE VIBRAÇÃO INDEPENDENTE

O **Modo Vibração** dedicado pode ser usado de forma independente para massagear suavemente o seio, ajudando a estimular o fluxo de leite e aliviar o desconforto. Também pode ser ativado durante os modos de Estimulação, Extração ou Anti-Stase para suporte adicional.



EXTRAÇÃO CONFORTÁVEL NA POSIÇÃO RECLINADA

Projetado para uso sentada com apoio para as costas (inclinação de até 130°), tornando o processo de extração mais relaxante.



CONE DE SILICONE DELICADO COM A PELE

Equipado com um cone de silicone macio de 24 mm que se adapta suavemente ao seio para um encaixe seguro e confortável.



TECNOLOGIA CAREFLO™:

Ao contrário das bombas tira-leite tradicionais de 2 fases, o sistema CareFlo™ introduz uma terceira fase de drenagem anticongestão, além das etapas habituais de estimulação e extração. Os seus benefícios incluem:

- Estimular uma produção de leite mais regular e constante.
- Prevenir a obstrução dos canais e a mastite.
- Aliviar a tensão e a sensação de peito cheio.
- Favorecer uma amamentação mais prolongada e sem interrupções.



FUNÇÃO NIPFIT™:

Correção de mamilos planos ou invertidos.

Esta função foi desenvolvida para ajudar a corrigir os mamilos planos ou invertidos e auxiliar na extração de leite através de uma estimulação suave e progressiva:

- Ajuda o mamilo a projetar-se para fora.
- Facilita a pega correta do bebê à mama.
- Auxilia no início e na continuidade da amamentação.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize a funcionalidade NipFit™ se:

1. Tem feridas abertas, fissuras, lesões ou infecções ativas no mamilo ou na aréola.
2. Fez cirurgia mamária recentemente.
3. Tem um diagnóstico de inversão do mamilo causada por doença ou trauma, e não congênita. Nesse caso, consulte primeiro o seu médico.
4. Sente dor aguda desde a primeira aplicação. Interrompa o uso imediatamente.
5. Tem uma pele particularmente sensível ou sofre de problemas dermatológicos locais, como eczema ou psoríase.
6. Está grávida. A sucção pode estimular as contrações.



AVISO

A funcionalidade NipFit™ destina-se apenas ao uso pós-parto. Não utilize durante a gravidez.


AVISOS DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Comece sempre no nível mais baixo, Nível 1. Não aumente a intensidade até que o mamilo se adapte gradualmente, mesmo que a sensação seja confortável.
- Não exceda 5 a 10 minutos de utilização contínua da funcionalidade NipFit™ por sessão, especialmente nas primeiras semanas.
- Não realize mais de 2 sessões de correção por dia. O uso excessivo pode causar irritação, inchaço ou microlesões no mamilo.
- Interrompa imediatamente a utilização se sentir dor aguda, vermelhidão anormal, inchaço persistente, bolhas ou secreção de outro fluido que não seja leite.
- Este dispositivo não é um dispositivo médico certificado para terapia clínica e não substitui a consulta com uma parteira, médico ou Consultor Internacional de Lactação Certificado (IBCLC).
- Um mamilo invertido de Grau 3, severamente aderente, requer avaliação médica antes da utilização de qualquer dispositivo de correção.
- O uso prolongado e de alta intensidade pode provocar o inchaço da aréola, dificultando temporariamente a pega do bebé. Isto pode ter o efeito oposto ao desejado.

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA:

- Certifique-se de que o copo de silicone tem o tamanho correto, incluindo a flange de 24 mm ou os redutores de 20/22 mm, antes de ativar a funcionalidade NipFit™. Um copo demasiado grande pode amplificar a sucção na aréola de forma descontrolada.
- Antes da sessão, aplique algumas gotas de leite materno ou creme de lanolina pura para suavizar a zona.
- Durante a sessão NipFit™, o mamilo deve estar centrado no copo. Uma posição incorreta pode provocar sucção assimétrica e irritação.
- Se não notar melhorias após 4 a 6 semanas de utilização correta, consulte um profissional de saúde.

COMPONENTES DO PRODUTO






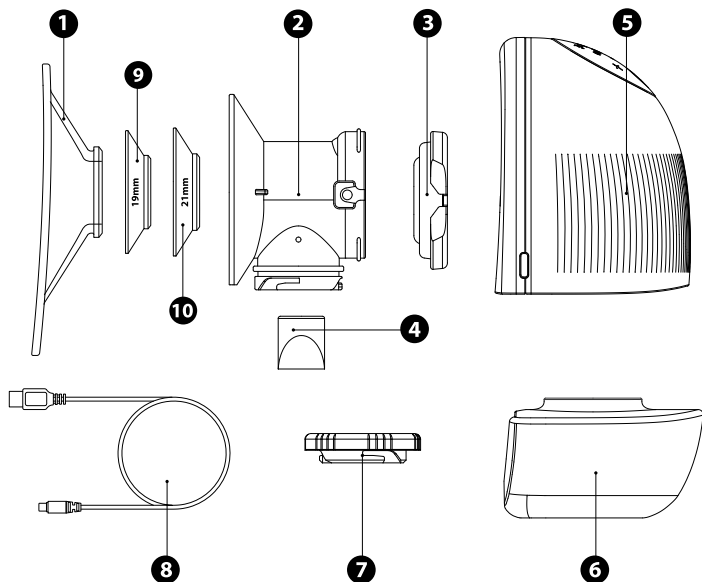


Nº	NOME	MATERIAL	TEMP. RESISTÊNCIA	QUANTIDADE
1	Copo de silicone	Silicone	-20~200°C	1
2	Corpo de montagem	PP	-20~120°C	1
3	Válvula anti-refluxo	Silicone	-20~200°C	1
4	Válvula de retenção	Silicone	-20~200°C	2
5	Unidade principal	/	/	1
6	Recipiente	Tritan	-20~105°C	1
7	Tampa	PP	-20~120°C	1
8	Cabo USB	/	/	1
9	Redutor 19mm	Silicone	-20~120°C	1
10	Redutor 21mm	Silicone	-20~120°C	1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Insira a válvula anti-retorno (3) no corpo de montagem (2) de forma que os entalhes de ambos os lados fiquem alinhados com as saliências laterais e pressione para garantir que esteja firmemente encaixado (conforme mostrado na figura A).
2. Instale a válvula de retenção (4) no cilindro sob o corpo de montagem e insira-a até o fundo para garantir uma vedação perfeita (conforme mostrado na figura B).
3. Alinhe a saliência interna do conector (6) com a ranhura sob o corpo de montagem e gire no sentido horário. Após a instalação, a linha central do recipiente e do corpo de montagem devem coincidir (conforme mostrado na figura C).
4. Insira o corpo de montagem e o recipiente na unidade principal na direção indicada na figura, certificando-se de que estejam firmemente fixados (conforme mostrado na figura D).
5. Alinhe o símbolo "▲" do silicone com o símbolo "▼" da unidade principal, pressionando o centro do silicone para garantir um encaixe perfeito com o corpo de montagem (conforme mostrado na figura E).

NOTA: Antes de iniciar a extração do leite, verifique se todos os acessórios estão corretamente montados e fixados firmemente.




MÉTODO DE CARREGAMENTO

Este produto utiliza uma interface USB para o cabo de carregamento, permitindo várias formas de alimentação:

1. Conexão a uma porta USB do computador.
2. Conexão com o adaptador incluído (5V2A).
3. Conexão a um power bank (use um power bank de boa qualidade para evitar danos ao produto).

O dispositivo reconhece automaticamente o nível da bateria.

- A tela da unidade principal possui um ícone de alimentação da bateria para indicar o nível atual de carga. Se o símbolo da bateria "🔋" piscar durante o uso ou ao ligar, isso indica que a unidade principal precisa ser recarregada imediatamente.
- Uma vez conectado o dispositivo à alimentação para carregar, o símbolo da bateria "🔋" pisca indicando que está carregando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o símbolo "🔋" permanecerá fixo.



NOTA: Desligue o dispositivo antes de conectá-lo ao carregador para recarregar.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO

A1: Botão Liga/Desliga e Seleção de modo:

Pressione e segure para ligar ou desligar, pressione brevemente para mudar o modo de funcionamento.

A2: Botão para diminuir a intensidade

A3: Botão para aumentar a intensidade

A2+A3: Nos modos de estimulação, extração e anti-estase, pressione simultaneamente os botões A2 e A3 para adicionar a função de vibração ao modo de trabalho atual. Pressione novamente para desativar a função de vibração.

B1: Indicador do modo de estimulação


B2: Indicador do modo de extração

B3: Indicador do modo anti-estase

B4: Indicador do modo de vibração

B5: Indicador de nível e tempo (quando o modo de trabalho é alterado, primeiro aparece o modo atual, depois o tempo de funcionamento)

B1+B3: Função NipFit™ ativada



MODO ESTIMULAÇÃO (NÍVEL 1~5): Neste modo, a bomba de leite gera um ritmo de sucção relativamente rápido com uma potência de sucção baixa. É projetado para estimular suavemente os tecidos mamários e favorecer a extração do leite, imitando o comportamento inicial de sucção superficial de um recém-nascido. Recomenda-se usar este modo antes de passar para os demais.

MODO EXPRESSÃO (NÍVEL 1~9): Este modo imita o ritmo de sucção mais profundo e lento de um bebê durante a amamentação ativa. A força de sucção é mais alta e a frequência é mais lenta do que no modo estimulação. Esta configuração foi desenvolvida para ajudar a extrair o leite de forma mais eficaz, uma vez iniciada a extração.

MODO ANTI-ESTASE (NÍVEL 1~9): Este modo atua com pulsos e é direcionado para remover cuidadosamente o leite residual no seio após a extração. O uso regular pode ajudar a prevenir a estase do leite, reduzir o risco de ductos obstruídos e manter o fluxo do leite.




MODO VIBRAÇÃO FUNÇÃO NIPFIT™ (NÍVEL 1~3): A bomba utiliza 13.000 impulsos delicados por minuto para estimular profundamente o seio, ajudando a liberar os ductos lactíferos e facilitar a extração do leite.

FUNÇÃO NIPFIT™: Para ativar a função de correção dos mamilos, pressione o botão de modo até que os ícones (B1) e (B3) comecem a piscar. A função tem 3 níveis de intensidade.


NOTA: Durante os modos de estimulação e extração, a vibração opera a uma intensidade predefinida fixa e não pode ser ajustada. A velocidade de vibração só pode ser aumentada ou diminuída quando se utiliza o modo de vibração isolada.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Lave bem as mãos antes do uso. Certifique-se de que todos os componentes da bomba de leite foram devidamente limpos e montados corretamente conforme as instruções. (Antes de iniciar a extração, recomenda-se usar uma toalha quente para comprimir e massagear o seio, a fim de facilitar a liberação do leite).
2. Posicione a bomba montada dentro do sutiã, ajustando o ângulo de modo que ela fique perfeitamente aderida ao seio (como mostrado na figura 1).
3. Pressione e segure o botão Liga/Selecionar Modo (A1) para ligar o dispositivo, que entrará automaticamente no modo de estimulação (nível padrão de estimulação: 3). Após 2 minutos de funcionamento, o dispositivo mudará automaticamente para o modo de extração (nível padrão: 5) (conforme mostrado na figura 2).
4. Durante o funcionamento, pressione brevemente o botão (A1) para alternar ciclicamente entre os modos de operação (conforme mostrado na figura 3).



5. Durante o funcionamento, pressione brevemente os botões (A2) e (A3) para ajustar o nível de intensidade do modo em uso (conforme mostrado na figura 4).
6. Durante o funcionamento, pressione simultaneamente os botões (A2) e (A3) para adicionar o “modo vibração” ao modo de operação atual. Pressione novamente para desativar a vibração (conforme mostrado na figura 4).
7. Função de memória: o dispositivo lembra o último nível de operação utilizado nos modos estimulação, extração, antiestase e vibração, facilitando o uso com um único botão.
8. Durante o funcionamento, pressione e segure o botão (A1) para desligar o dispositivo.
9. Ao final da extração do leite, remova a mamadeira e transfira o leite materno para um recipiente apropriado para armazenamento (conforme mostrado na figura 5).



NOTA: Verifique a quantidade de leite a qualquer momento para evitar vazamentos. A bomba desligará automaticamente após 30 minutos de funcionamento contínuo nos modos de estimulação e extração, e após 5 minutos no modo antiestase.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A. ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes de usar a bomba pela primeira vez, limpe e desinfete cuidadosamente todas as peças (exceto a unidade principal e o cabo USB), seguindo as instruções de limpeza e desinfecção das seções B e C a seguir.

B. APÓS CADA USO

Lave cuidadosamente todas as partes (exceto a unidade principal) que entram em contato direto com o seio e o leite materno. Desmonte a bomba em partes separadas e enxágue todas as peças que entram em contato com o seio e o leite com água morna para remover qualquer resíduo.

C. DESINFECÇÃO DIÁRIA

- Lave bem as mãos.
- Separe todas as partes que entram em contato com o seio e o leite materno.
- Despeje água fria em um recipiente (em quantidade suficiente para cobrir completamente as peças).
- Após a água atingir o ponto de ebulição, mergulhe as peças por cerca de 5 minutos e depois retire-as cuidadosamente com uma pinça.
- Coloque as peças esterilizadas sobre uma toalha limpa.
- Guarde as peças em local seco. Evite armazená-las em ambientes escuros e úmidos quando não estiverem em uso.
- Durante a desinfecção, os acessórios não devem entrar em contato direto com as paredes metálicas do recipiente (recomenda-se usar uma gaze limpa como separador entre as peças e o recipiente).
- Como alternativa, é possível usar um esterilizador a vapor.

PRECAUÇÕES DE LIMPEZA

- Sempre desmonte todos os acessórios que entram em contato com o seio ou o leite materno (exceto a unidade principal).
- Após cada uso, limpe imediatamente as peças para evitar resíduos de leite e a proliferação de bactérias.
- Durante a montagem ou desmontagem, siga as instruções para cada componente.
- Durante a desmontagem e a limpeza, tome cuidado para não perder nenhuma peça, para evitar falhas durante a montagem ou o uso do produto.
- O silicone de estimulação, o silicone anti-refluxo e outros acessórios (exceto a unidade principal) podem ser esterilizados no esterilizador.
- Precauções para a desinfecção da válvula: **NÃO** ferver ou esterilizar a vapor por mais de 3 minutos.
- O recipiente é feito de material Tritan e **NÃO** é adequado para esterilização a vapor quente; recomenda-se a utilização de métodos de esterilização a frio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome do produto	1264W Materno Flow
Tensão de entrada	5V
Potência nominal	6W
Tensão da bateria	3,7V
Garantia	1 ano
Capacidade da bateria	1300mAh / 4,81Wh
Local de fabricação	PRC

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto está coberto por uma garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico, a contar da data de compra comprovada por recibo ou fatura. Se a compra tiver sido efetuada com fatura, a garantia legal é reduzida para 12 meses. A garantia de 24 meses não cobre danos resultantes do desgaste normal, danos estéticos, acessórios ou consumíveis (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a desgaste). As baterias estão cobertas por uma garantia de 6 meses. Os termos e condições completos da garantia estão disponíveis em

www.nuvitababy.com/warranty

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το φορητό ηλεκτρικό θήλαστρο Nuvita 1264W. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο κατά τη διάρκεια του μπάνιου.
2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
3. Αποφύγετε την έκθεση του θήλαστρου σε υψηλές θερμοκρασίες ή απευθείας ηλιακό φως.
4. Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, για αποφυγή κινδύνων, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο.
5. Κρατήστε όλα τα μη χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα μακριά από παιδιά ώστε να μην τα καταπιούν ή προκληθούν ατυχήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1. Απαγορεύεται η χρήση ή η φόρτιση του προϊόντος κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε χώρους όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45°C.
2. Απαγορεύεται η εμφύσηση της κύριας μονάδας ή του καλωδίου φόρτισης USB σε υγρά, όπως νερό, βενζίνη, ποτά κ.λπ.
3. Απαγορεύεται η ρίψη της κύριας μονάδας στη φωτιά ή η θέρμανσή της.
4. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με σακουλάκια και υλικά συσκευασίας για αποφυγή κινδύνου ασφυξίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.
- Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι κάθε μέρος έχει τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Ρυθμίστε την ένταση αναρρόφησης σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες, ώστε να γίνει η εξαγωγή του γάλακτος πιο άνετα.
- Μην γέρνετε ή γεμίζετε υπερβολικά το μπουκάλι (μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο ένδειξης).
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη θερμοκρασία του υγρού στο μπουκάλι για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Συνιστάται η χρήση του θήλαστρου υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες γιατρού ή ειδικευμένου επαγγελματία υγείας.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά το θήλαστρο για να αποφύγετε τραυματισμούς στο στήθος.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό θηλασμού ή τον γιατρό σας σε περίπτωση προβλημάτων ή πόνου.
- Τα εξαρτήματα του θήλαστρου που έρχονται σε άμεση επαφή με το μητρικό γάλα είναι

προσωπικά αντικείμενα και δεν θα πρέπει να τα μοιράζονται οι μητέρες με άλλους ανθρώπους.

- Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς η άντληση γάλακτος μπορεί να προκαλέσει αποβολή.
- Μην συνεχίσετε την άντληση γάλακτος για πάνω από 5 λεπτά αν δεν βγαίνει γάλα.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Nuvita 1264W Materno Flow είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τις μητέρες που θηλάζουν, μιμνούμενο τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού. Αυτό το φορετό ηλεκτρικό θήλαστρο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθά τις μαμάδες να αντλούν το μητρικό γάλα αποτελεσματικά και άνετα ακόμη και εκτός σπιτιού, εξασφαλίζοντας μια εύκολη και ανώδυνη εμπειρία. Διαθέτει 9 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης, τη λειτουργία NipFit™ και την τεχνολογία 3 φάσεων Careflo™.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Η ειδική Λειτουργία Δόνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για να κάνει απαλό μασάζ στο στήθος, βοηθώντας να διεγείρει τη ροή του γάλακτος και να μειώσει την ενόχληση. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Διέγερσης, Άντλησης ή Κατά της Στάσης για επιπλέον υποστήριξη.



ΑΝΕΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ ΞΑΠΛΩΤΗ ΘΕΣΗ

Σχεδιασμένο για χρήση καθιστή με υποστήριξη πλάτης (κλίση έως και 130°), κάνοντας τη διαδικασία άντλησης πιο χαλαρωτική.



ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

Εξοπλισμένο με απαλή θηλή σιλικόνης 24 mm που προσαρμόζεται απαλά στο στήθος για ασφαλή και άνετη εφαρμογή.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CAREFLO™:

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά θήλαστρα 2 φάσεων, το CareFlo™ εισάγει μια τρίτη φάση αποστράγγισης κατά της στάσης του γάλακτος, πέρα από τα συνήθη στάδια διέγερσης και άντλησης. Αυτό βοηθά στην:

- Προώθηση μιας πιο σταθερής παραγωγής γάλακτος.
- Πρόληψη της απόφραξης των πόρων και της μαστίτιδας.
- Ανακούφιση από την τάση και την αίσθηση πληρότητας στο στήθος.
- Υποστήριξη ενός πιο ομαλού θηλασμού χωρίς διακοπές.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NIPFIT™:

Διόρθωση επίπεδων ή ανεστραμμένων θηλών.

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στη διόρθωση επίπεδων ή ανεστραμμένων θηλών και να υποστηρίξει την εξαγωγή γάλακτος μέσω απαλής, προοδευτικής διέγερσης:

- Βοηθά τη θηλή να προεξέχει προς τα έξω.
- Διευκολύνει το μωρό να πιάνει το στήθος.
- Υποστηρίζει την έναρξη και τη συνέχιση του θηλασμού

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NipFit™ εάν:

1. Έχετε ανοιχτές πληγές, ρωγμές, αλλοιώσεις ή ενεργές μολύνσεις στη θηλή ή την θηλαία άλω.
2. Έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στο στήθος.
3. Έχετε διαγνωσμένη πάθηση αναστροφής θηλής που προκαλείται από ασθένεια ή τραύμα, όχι συγγενή. Εάν συμβαίνει αυτό, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.
4. Αισθάνεστε οξύ πόνο από την πρώτη εφαρμογή. Διακόψτε αμέσως τη χρήση.
5. Έχετε ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα ή πάσχετε από τοπικές δερματολογικές παθήσεις, όπως έκζεμα ή ψωρίαση.
6. Είστε έγκυος. Η αναρρόφηση μπορεί να διεγείρει συσπάσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία NipFit™ προορίζεται μόνο για χρήση μετά τον τοκετό. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξεκινάτε πάντα από το χαμηλότερο επίπεδο, Επίπεδο 1. Μην αυξάνετε την ένταση μέχρι η θηλή να προσαρμοστεί σταδιακά, ακόμα κι αν η αίσθηση είναι άνετη.
- Μην υπερβαίνετε τα 5-10 λεπτά συνεχούς χρήσης της λειτουργίας NipFit™ ανά συνεδρία, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες.
- Μην εκτελείτε περισσότερες από 2 συνεδρίες διόρθωσης την ημέρα. Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, πρήξιμο ή μικροσχίματα στη θηλή.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε οξύ πόνο, ασυνήθιστη ερυθρότητα, επίμονο πρήξιμο, φουσκάλες ή έκκριση υγρού εκτός από γάλα.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη ιατρική συσκευή για κλινική θεραπεία και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή μαιάς, γιατρού ή Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC).
- Μια ανεστραμμένη θηλή Βαθμού 3, με έντονη προσκόλληση, απαιτεί ιατρική αξιολόγηση πριν από τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής διόρθωσης.
- Η παρατεταμένη χρήση υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο της θηλαίας άλω, καθιστώντας προσωρινά πιο δύσκολο για το μωρό να πιάσει τη θηλή. Αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο σιλικόνης έχει το σωστό μέγεθος, συμπεριλαμβανομένης της φλάντζας 24 mm ή των μειωτήρων 20/22 mm, πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NipFit™. Ένα κύπελλο που είναι πολύ μεγάλο μπορεί να ενισχύσει την αναρρόφηση στην θηλαία άλω με ανεξέλεγκτο τρόπο.
- Πριν από τη συνεδρία, εφαρμόστε μερικές σταγόνες μητρικού γάλακτος ή κρέμας καθαρής λανολίνης για να μαλακώσετε την περιοχή.
- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας NipFit™, η θηλή πρέπει να είναι κεντραρισμένη στο κύπελλο. Μια λανθασμένη θέση μπορεί να προκαλέσει ασύμμετρη αναρρόφηση και ερεθισμό.
- Εάν δεν παρατηρήσετε καμία βελτίωση μετά από 4-6 εβδομάδες σωστής χρήσης, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.







ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

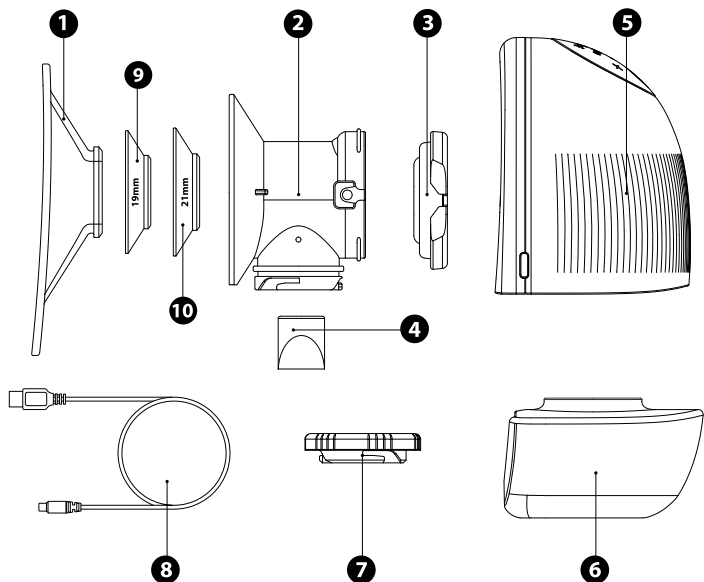

ΑΡ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλύπτρα σιλικόνης	Σιλικόνη	-20~200°C	1
2	Σώμα συναρμολόγησης	PP	-20~120°C	1
3	Βαλβίδα αντι-επιστροφής	Σιλικόνη	-20~200°C	1
4	Βαλβίδα μονής ροής	Σιλικόνη	-20~200°C	2
5	Κύρια μονάδα	/	/	1
6	Δοχείο συλλογής	Tritan	-20~105°C	1
7	Καπάκι	PP	-20~120°C	1
8	Καλώδιο USB	/	/	1
9	Περιστέλλον 19mm	Σιλικόνη	-20~120°C	1
10	Περιστέλλον 21mm	Σιλικόνη	-20~120°C	1

1. Εισάγετε τη βαλβίδα αντι-επιστροφής **(3)** στο σώμα συναρμολόγησης **(2)** έτσι ώστε οι εγκοπές και στις δύο πλευρές να ευθυγραμμίζονται με τις προεξοχές στις πλευρές και πιέστε για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά (όπως φαίνεται στην εικόνα A).
2. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα μονής ροής **(4)** στον κύλινδρο κάτω από το σώμα συναρμολόγησης και σπρώξτε την μέχρι κάτω για να εξασφαλίσετε τέλεια στεγανοποίηση (όπως φαίνεται στην εικόνα B).
3. Ευθυγραμμίστε την εσωτερική προεξοχή του συνδέσμου **(6)** με την εγκοπή κάτω από το σώμα συναρμολόγησης και περιστρέψτε δεξιόστροφα. Μετά την τοποθέτηση, η κεντρική γραμμή του δοχείου και του σώματος συναρμολόγησης πρέπει να συμπίπτουν (όπως φαίνεται στην εικόνα C).
4. Τοποθετήστε το σώμα συναρμολόγησης και το δοχείο μέσα στη βασική μονάδα σύμφωνα με την κατεύθυνση της εικόνας, διασφαλίζοντας ότι έχουν στερεωθεί σωστά στη θέση τους (όπως φαίνεται στην εικόνα D).
5. Ευθυγραμμίστε το σύμβολο "▲" στη σιλικόνη με το σύμβολο "▼" στη βασική μονάδα, πιέζοντας το κέντρο της σιλικόνης για να εξασφαλίσετε τέλεια σύνδεση με το σώμα συναρμολόγησης (όπως φαίνεται στην εικόνα E).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε την άντληση του γάλακτος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί και στερεωθεί σωστά. Αν επιθυμείς, μπορείς να συνεχίσω και με τη μετάφραση της εικόνας F ή των υπόλοιπων σελίδων.



ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί θύρα USB για το καλώδιο φόρτισης, που επιτρέπει πολλαπλές μεθόδους τροφοδοσίας:

1. Σύνδεση σε θύρα USB του υπολογιστή.
2. Σύνδεση με τον παρεχόμενο αντάπτορα (5V2A).
3. Σύνδεση με power bank (συνιστάται χρήση ποιοτικού power bank για αποφυγή βλαβών στο προϊόν).

Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα το επίπεδο της μπαταρίας.

- Η οθόνη της κύριας μονάδας διαθέτει ένα σύμβολο φόρτισης για την ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας. Εάν το σύμβολο της μπαταρίας "  " αναβοσβήνει κατά την ενεργοποίηση ή τη χρήση, σημαίνει ότι η κύρια μονάδα χρειάζεται άμεση φόρτιση.
- Μόλις συνδεθεί η συσκευή για φόρτιση, το σύμβολο της μπαταρίας "  " θα αναβοσβήνει για να δείξει ότι φορτίζει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το σύμβολο "  " θα παραμείνει σταθερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη συνδέσετε στην τροφοδοσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

A1: Κουμπί ενεργοποίησης/επιλογής λειτουργίας: πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, πατήστε σύντομα για να αλλάξετε λειτουργία.

A2: Κουμπί μείωσης έντασης

A3: Κουμπί αύξησης έντασης

A2 + A3: Στις λειτουργίες διέγερσης/άντλησης/αντι-στάσης, πατήστε ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιπλέον δόνησης στη λειτουργία εργασίας. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση της δόνησης.

B1: Ένδειξη λειτουργίας διέγερσης



B2: Ένδειξη λειτουργίας άντλησης

B3: Ένδειξη λειτουργίας αντι-στάσης

B4: Ένδειξη λειτουργίας δόνησης

B5: Ένδειξη επιπέδου και χρόνου (όταν αλλάξει η λειτουργία, εμφανίζεται πρώτα η τρέχουσα λειτουργία και στη συνέχεια ο χρόνος λειτουργίας)

B1+B3: Η λειτουργία NipFit™ ενεργοποιήθηκε

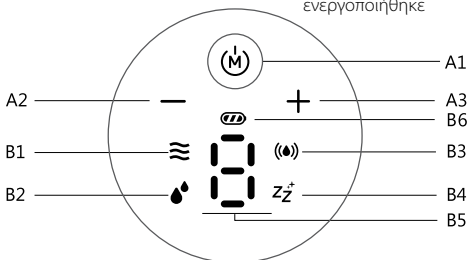

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1~5): Σε αυτή τη λειτουργία, το θήλαστρο δημιουργεί έναν σχετικά γρήγορο ρυθμό αναρρόφησης με χαμηλή ισχύ αναρρόφησης. Έχει σχεδιαστεί για να διεγείρει απαλά τους ιστούς του στήθους και να διευκολύνει την εξαγωγή του γάλακτος, μιμούμενο την επιφανειακή αναρρόφηση ενός νεογέννητου. Συνιστάται η χρήση αυτής της λειτουργίας στην αρχή πριν τη μετάβαση σε άλλες λειτουργίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1~9): Αυτή η λειτουργία μιμείται τον βαθύτερο και πιο αργό ρυθμό αναρρόφησης ενός βρέφους κατά τη διάρκεια ενεργού θηλασμού. Η ισχύς αναρρόφησης είναι υψηλότερη και η συχνότητα χαμηλότερη σε σχέση με τη λειτουργία διέγερσης. Είναι κατάλληλη για πιο αποτελεσματική εξαγωγή γάλακτος όταν έχει ξεκινήσει ήδη η ροή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙ-ΣΤΑΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1~9): Αυτή η λειτουργία λειτουργεί με παλμικό τρόπο και στοχεύει στην απομάκρυνση του υπολειπόμενου γάλακτος από το στήθος μετά την άντληση. Η τακτική χρήση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της στάσης γάλακτος, στη μείωση του κινδύνου φραγμένων πόρων και στη διατήρηση της ροής του γάλακτος.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1~3): Το θήλαστρο χρησιμοποιεί 13.000 απαλούς παλμούς το λεπτό για να διεγείρει σε βάθος το στήθος, συμβάλλοντας στο άνοιγμα των γαλακτοφόρων πόρων και στη διευκόλυνση της άντλησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NIPFIT™: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης θηλών, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια (B1) και (B3). Η λειτουργία έχει 3 επίπεδα έντασης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών διέγερσης και εξαγωγής, η δόνηση λειτουργεί με σταθερή προκαθορισμένη ένταση και δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Η ταχύτητα δόνησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία μόνο δόνησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του θηλάστρου έχουν καθαριστεί και συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες. (Πριν ξεκινήσετε την άντληση, συνιστάται η χρήση μιας ζεστής πετσέτας για να πιέσετε και να κάνετε μασάζ στο στήθος, ώστε να διευκολυνθεί η έκκριση του γάλακτος).
2. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο θήλαστρο μέσα στο στήθοδεσμο, ρυθμίζοντας τη γωνία ώστε να εφαρμόζει τέλεια στο στήθος (όπως φαίνεται στην εικόνα 1).
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Επιλογής λειτουργίας (A1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η οποία θα ξεκινήσει αυτόματα με τη λειτουργία διέγερσης (προεπιλεγμένο επίπεδο διέγερσης: 3). Μετά από 2 λεπτά λειτουργίας, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία άντλησης (προεπιλεγμένο επίπεδο: 5) (όπως φαίνεται στην εικόνα 2).



4. Κατά τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το κουμπί (A1) για να αλλάξετε κυκλικά από τη μία λειτουργία εργασίας στην άλλη (όπως φαίνεται στην εικόνα 3).
5. Κατά τη λειτουργία, πατήστε σύντομα τα κουμπιά (A2) και (A3) για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης της τρέχουσας λειτουργίας (όπως φαίνεται στην εικόνα 4).
6. Κατά τη λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά (A2) και (A3) για να προσθέσετε τη “λειτουργία δόνησης” στη λειτουργία που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης (όπως φαίνεται στην εικόνα 4).



7. Λειτουργία μνήμης: η συσκευή θυμάται το τελευταίο επίπεδο λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε στις λειτουργίες διέγερσης, άντλησης, κατά της στασιμότητας και δόνησης, διευκολύνοντας τη χρήση με ένα μόνο κουμπί.
8. Κατά τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (A1) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
9. Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης, αφαιρέστε το μπιμπερό και μεταφέρετε το μητρικό γάλα σε κατάλληλο δοχείο για αποθήκευση (όπως φαίνεται στην εικόνα 5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την ποσότητα γάλακτος για να αποφύγετε υπερχειλίσεις. Το θήλαστρο θα σταματήσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας στις λειτουργίες διέγερσης και άντλησης και μετά από 5 λεπτά στη λειτουργία κατά της στασιμότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

A. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το θήλαστρο για πρώτη φορά, καθαρίστε και απολυμάνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα (εκτός από την κύρια μονάδα και το καλώδιο USB), ακολουθώντας τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης που περιγράφονται στις ενότητες Β και C παρακάτω.

B. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα μέρη (εκτός από την κύρια μονάδα) που έρχονται σε άμεση επαφή με το στήθος και το μητρικό γάλα. Αποσυναρμολογήστε το θήλαστρο σε επιμέρους μέρη και ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το στήθος και το μητρικό γάλα με χλιαρό νερό για να απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα.

C. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

- Πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας.
- Χωρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το στήθος και το μητρικό γάλα.
- Ρίξτε κρύο νερό σε ένα δοχείο (σε ποσότητα επαρκή ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα εξαρτήματα).
- Αφού βράσει το νερό, βυθίστε τα εξαρτήματα για περίπου 5 λεπτά, έπειτα αφαιρέστε τα προσεκτικά με λαβίδα.
- Τοποθετήστε τα αποστειρωμένα εξαρτήματα πάνω σε καθαρή πετσέτα.
- Φυλάξτε τα εξαρτήματα σε στεγνό μέρος. Αποφύγετε την αποθήκευση σε σκοτεινά και υγρά περιβάλλοντα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

- Κατά την απολύμανση, τα εξαρτήματα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μεταλλικά τοιχώματα του δοχείου (συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης γάλας ως διαχωριστικό μεταξύ εξαρτημάτων και δοχείου).
- Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποστειρωτής ατμού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Πάντα να αποσυναρμολογείτε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το στήθος ή το μητρικό γάλα (εκτός από την κύρια μονάδα).
- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε αμέσως τα εξαρτήματα για να αποφύγετε υπολείμματα γάλακτος και ανάπτυξη βακτηρίων.
- Κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες για κάθε εξάρτημα.
- Δώστε προσοχή κατά τον καθαρισμό ώστε να μη χαθεί κάποιο μέρος, ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Η θηλή διέγερσης, η αντι-επιστροφή σιλικόνης και άλλα εξαρτήματα (εκτός της κύριας μονάδας) μπορούν να αποστειρωθούν με αποστειρωτή.
- Προσοχή στην αποστείρωση της βαλβίδας: **ΜΗ ΒΡΑΖΕΤΕ** ή αποστειρώνετε με ατμό για περισσότερο από 3 λεπτά.
- Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από υλικό Tritan και **ΔΕΝ** είναι κατάλληλο για αποστείρωση με ζεστό ατμό. Συνιστώνται αντί αυτού μέθοδοι ψυχρής αποστείρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος	1264W Materno Flow
Τάση εισόδου	5V
Ονομαστική ισχύς	6W
Τάση μπαταρίας	3.7V
Εγγύηση	1 έτος
Χωρητικότητα μπαταρίας	1300mAh 4.81Wh
Τόπος παραγωγής	Κίνα

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών για κατασκευαστικά ελαττώματα, η οποία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, όπως αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο. Σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο, η νόμιμη εγγύηση περιορίζεται σε 12 μήνες. Η εγγύηση 24 μηνών δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, αισθητικές αλλοιώσεις, εξαρτήματα ή αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες, κεφαλές βουρτσών ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά). Οι μπαταρίες καλύπτονται από εγγύηση 6 μηνών. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.nuvitababy.com/warranty

Takk for at du kjøpte den bærbare elektriske brystpumpen Nuvita 1264W. Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR DIN OG DINE BARNES SIKKERHET OG HELSE ER ALT INNHOLDET I DETTE PROSJEKTET RELATERT TIL SIKKERHET. SØRG FOR Å OVERHOLDE DET.

ADVARSEL

1. Ikke bruk brystpumpen i badekaret.
2. Vennligst oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn eller kjæledyr.
3. Sørg for at brystpumpen ikke utsettes for høy temperatur eller direkte sollys.
4. Hvis produktet er skadet, må det for å unngå fare erstattes av produsenten eller andre fagfolk i vedlikeholdsavdelinger eller lignende avdelinger.
5. Oppbevar alle ubrukte deler utilgjengelig for barn for å unngå at de svelges av barn eller andre farlige ulykker.

FARE

1. Det er forbudt å bruke eller lade i nærheten av en ildkilde eller i omgivelser der temperaturen overstiger 45 C.
2. Det er forbudt å legge vertsdatamaskinen og USB-ladekabelen i væske, som vann, bensin, drikkevarer osv.
3. Det er forbudt å kaste hovedenheten i ilden eller varme den opp.
4. Ikke la barn leke med produktemballasjeposen for å unngå kveldningsfare.

MERKNAD

- Vennligst lad den opp før du bruker den for første gang.
- Når du monterer, må du sørge for å montere hver del i henhold til monteringsanvisningen.
- Still inn sugestyrken i henhold til din personlige fysikk og fullfør brystpumpingen med komfortabel suging.
- Ikke vipp eller overfyll flasken (ikke overskrid den maksimale skalalinjen).
- Mål temperaturen på væsken i tåteflasken for å forhindre at babyen skålder seg før du bruker den.
- Bruk brystpumpen under veiledning av leger og sykepleiere når du ønsker å bruke den i stadiet med lav ammegrad.
- Ikke overamm for å unngå brystskader.
- Kontakt ammespesialisten eller legen din hvis det er noen problemer eller smerter.
- Delene av brystpumpen som kommer i direkte kontakt med morsmelk er personlig pleieutstyr, og mødre bør ikke dele dem.
- Ikke bruk brystpumpe under graviditet, da dette kan føre til spontanabort.

- Ikke fortsett å pumpe melk i mer enn 5 minutter hvis det ikke suges ut melk.
- Dette produktet er kun til formålene som er beskrevet i bruksanvisningen.

INFORMASJON

Nuvita 1264W Materno Flow er utviklet for å støtte ammende mødre ved å etterligne babyens naturlige sugerytme. Denne bærbare, elektriske brystpumpen er spesielt designet for at mødre skal kunne pumpe morsmelk effektivt og komfortabelt, selv når de er på farten. Den sikrer en smertefri og praktisk pumpeopplevelse, og har 9 justerbare intensitetsnivåer, NipFit™-funksjon samt 3-faset Careflo™-teknologi.



UAVHENGIG VIBRASJONSFASE

Den dedikerte **vibrasjonsfasen** kan brukes uavhengig for å forsiktig stimulere brystene, noe som bidrar til å stimulere melkestrømmen og lindre ubehag. Den kan også aktiveres under stimulerings-, utpumpings- eller antistasefasene for ekstra støtte.



KOMFORTABEL PUMPING MENS DU LIGGER TILBAKE

Utviklet for bruk sittende med ryggstøtte (legg tilbake opptil 130°), noe som gjør pumpeprosessen mer avslappende.



HUDVENNLIG SILIKON BRYSTKOPP

Utstyrt med en 24 mm myk silikonkopp som former seg forsiktig etter brystet for en sikker og komfortabel passform.



CAREFLO™-TEKNOLOGI:

I motsetning til tradisjonelle 2-fasede brystpumper, introduserer CareFlo™ en tredje dreneringsfase mot melkestau, i tillegg til de vanlige stimulerings- og utpumpingstrinnene. Dette bidrar til å:

- Fremme en mer stabil og jevn melkeproduksjon.
- Forebygge tette melkeganger og brystbetennelse (mastitt).
- Lindre spenning og følelsen av tunge bryster.
- Støtte en mer harmonisk og uavbrutt ammeperiode.



NIPFIT™-FUNKSJON:

Korrigerer av flate eller innovervendte brystvorter.

Denne funksjonen ble utviklet for å korrigere flate eller innovervendte brystvorter og hjelpe til med melkeutvinning gjennom skånsom og progressiv stimulering:

- Hjelper brystvorten med å stikke utover.
- Forenkler korrekt feste av babyen til brystet.
- Hjelper med å starte og fortsette ammingen.

KONTRAINDIKASJONER

Ikke bruk NipFit™-funksjonen hvis:

1. Du har åpne sår, sprekker, lesjoner eller aktive infeksjoner på brystvorten eller areolaen.
2. Du har nylig gjennomgått en brystoperasjon.
3. Du har en diagnostisert tilstand med brystvorteinversjon forårsaket av sykdom eller traume, ikke medfødt. Hvis dette er tilfelle, kontakt legen din først.
4. Du opplever skarp smerte fra første påføring. Avbryt bruken umiddelbart.
5. Du har spesielt sensitiv hud eller lider av lokale dermatologiske tilstander, som eksem eller psoriasis.
6. Du er gravid. Sugning kan stimulere rier.



ADVARSEL

NipFit™-funksjonen er kun beregnet for bruk etter fødsel. Skal ikke brukes under graviditet.


ADVARSLER UNDER BRUK

- Start alltid på det laveste nivået, nivå 1. Ikke øk intensiteten før brystvorten gradvis har tilpasset seg, selv om følelsen er behagelig.
- Ikke bruk NipFit™-funksjonen kontinuerlig i mer enn 5–10 minutter per økt, spesielt de første ukene.
- Ikke utfør mer enn 2 korreksjonsøkter per dag. Overdreven bruk kan forårsake irritasjon, hevelse eller mikrorifter i brystvorten.
- Avbryt bruken umiddelbart hvis du opplever skarp smerte, unormal rødhet, vedvarende hevelse, blemmer eller utskillelse av annen væske enn melk.
- Denne enheten er ikke et sertifisert medisinsk utstyr for klinisk behandling og erstatter ikke konsultasjon med jordmor, lege eller International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- En grad 3, alvorlig fastklebende invertert brystvorte krever medisinsk evaluering før bruk av korreksjonsutstyr.
- Langvarig bruk med høy intensitet kan forårsake hevelse i areolaen, noe som midlertidig gjør det vanskeligere for babyen å feste seg. Dette kan ha motsatt effekt av den ønskede.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK:

- Sørg for at silikonkoppen har riktig størrelse, inkludert 24 mm flens eller 20/22 mm reduksjonsstykker, før du aktiverer NipFit™-funksjonen. En kopp som er for stor kan forsterke sugekraften på areolaen på en ukontrollert måte.
- Før behandlingen, påfør noen dråper morsmelk eller ren lanolinkrem for å myke opp området.
- Under NipFit™-behandlingen skal brystvorten være sentrert i koppen.
- Feil posisjon kan forårsake asymmetrisk sugekraft og irritasjon.
- Hvis du ikke merker noen forbedring etter 4–6 uker med riktig bruk, bør du kontakte helsepersonell.

PRODUKTKOMPONENTER






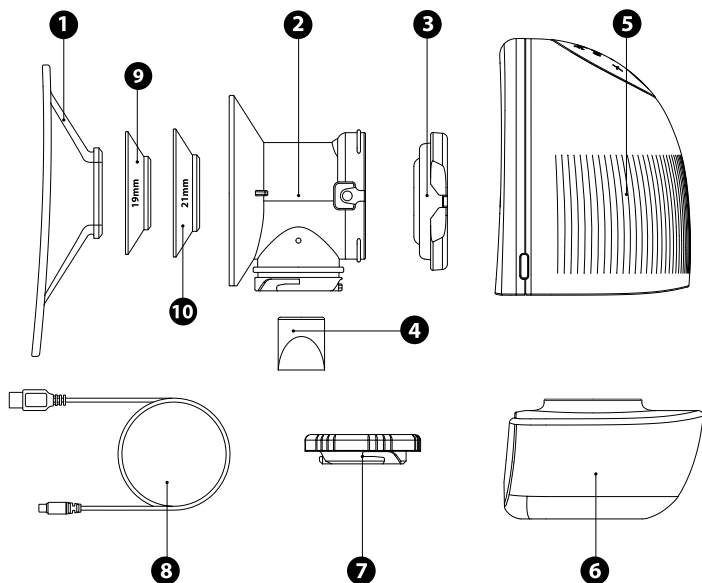


N	NAVN	MATERIALE	TEMP. MOTSTAND	MENGDE
1	Silikonkopp	Silikon	-20~200°C	1
2	Monteringsenhet	PP	-20~120°C	1
3	Anti-tilbakestrømningsventil	Silikon	-20~200°C	1
4	Tilbakeslagsventil	Silikon	-20~200°C	2
5	Hovedenhet	/	/	1
6	Kontakt	Tritan	-20~105°C	1
7	Lokk	PP	-20~120°C	1
8	USB-kabel	/	/	1
9	Reduser 19mm	Silikon	-20~120°C	1
10	Reduser 21mm	Silikon	-20~120°C	1

MONTERINGSANVISNING

1. Trykk tilbakeslagsventilen (3) på monteringsenheten (2) slik at hakkene på begge sider er på linje med utstikkerne på begge sider av monteringsenheten, og trykk den flat for å sikre en tett passform (som vist i figur A).
2. Monter tilbakeslagsventilen (4) på sylindren under monteringsenheten og monter den helt til enden slik at den sitter tett (som vist i figur B).
3. Juster utstikkeren på innsiden av flaskehalsen (6) med sporet under monteringsenheten og roter den med klokken. Etter montering skal midtlinjen til tåteflasken og monteringsenheten sammenfalle (som vist i figur C).
4. Trykk monteringsenheten og flaskeenheten inn i hovedenheten i retningen som vises på figuren for å sikre at de er installert på plass (som vist i figur D).
5. Juster ▲ på silikonkoppen med ▼ på hovedenheten, og trykk på ringen midt på silikonkoppen for å sikre at den passer tett inn i monteringsenheten (som vist i figur E).

MERK: Sjekk om tilhørende tilbehør er riktig montert og tett før du pumper brystet.



LADEMETODE


Dette produktet bruker et USB-ladekabelgrensesnitt, som kan forsyne strøm på flere måter.

1. Koble til en USB-port på datamaskinen for bruk.
2. Koble til den medfølgende strømadapteren (5V2A).
3. Koble til en powerbank for bruk (bruk en powerbank av god kvalitet for å unngå å skade dette produktet).

Maskinen gjenkjenner batterinivået automatisk.

- Skjermen på hovedenheten er utstyrt med et batterisymbol som viser gjeldende strøm. Hvis strømsymbolet  blinker under oppstart eller bruk, indikerer det at hovedenheten må lades opp i tide.
- Etter at strømforsyningen er koblet til lading, blinker batterisymbolet , noe som indikerer at batteriet lades. Når batteriet er fulladet, lyser batterisymbolet  alltid.

MERK: Slå av strømmen og koble deretter til strømadapteren for lading.



BESKRIVELSE AV PANELET

A1: Strøm-/fasebryterknapp: langt trykk for å slå av og på, kort trykk for å bytte arbeidsfase

A2: Knapp for reduksjon av intensitet

A3: Knapp for intensitetsøkning

A2+A3: I stimulerings-/ekspresjons-/antistasefasen, trykk på A2+A3-tasten samtidig for å legge til den ekstra vibrasjonsfunksjonen i den opprinnelige arbeidsfasen, og trykk igjen for å avbryte vibrasjonsfunksjonen.

B1: Stimuleringsindikator


B2: Uttrykksindikator

B3: Antistaseindikator

B4: Vibrasjonsindikator

B5: Nivå- og tidsindikator (Når arbeidsfasen byttes, vises arbeidsnivået først, og deretter arbeidstiden).

B1+B3: NipFit™-funksjonen er aktivert

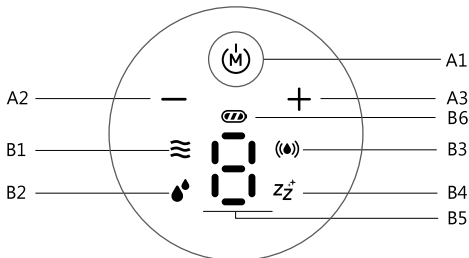

STIMULERINGSFASE (NIVÅ 1–5): I denne fasen genererer pumpen en relativt rask sugerytme med lav sugekraft. Den er utformet for å forsiktig stimulere brystvevet og fremme melkeutstøting ved å imitere babyens innledende, grunne sugelatferd. Det anbefales å bruke denne fasen før man bytter til andre faser.

UTMULERINGSFASE (NIVÅ 1–9): Denne fasen etterligner den dypere og langsommere sugerytmen til en baby når den aktivt drikker melk. Sugekraften er høyere, og frekvensen er lavere sammenlignet med stimuleringsfasen. Denne innstillingen er ment å bidra til å trekke ut melk mer effektivt når melkeutløsningsrefleksen har startet.

ANTISTASE-SUKSJONSFASEN (NIVÅ 1–9): Denne fasen gir et pulserende sugemønster som tar sikte på å fjerne gjenværende melk i brystet etter utpumping. Regelmessig bruk kan bidra til å forhindre melkestase, redusere risikoen for tette melkeganger og opprettholde melkestrømmen.




VIBRASJONSFASE (NIVÅ 1–3): Brystpumpen bruker 13 000 milde impulser per minutt for å stimulere brystet dypt, noe som bidrar til å rense melkekanalene og legge til rette for melkeutvinning.

NIPFIT™-FUNKSJON: For å aktivere funksjonen for brystvorte korrigering, trykk på modusknappen til ikonene (B1) og (B3) begynner å blinke. Funksjonen har 3 intensitetsnivåer.


MERK: Under stimulerings- og ekstraksjonsmodusene opererer vibrasjonen med en fast forhåndsinnstilt intensitet og kan ikke justeres. Vibrasjonshastigheten kan bare økes eller reduseres når kun vibrasjonsmodus brukes.

BRUKSANVISNING

1. Vask hendene før bruk, sørg for at komponentene i brystpumpen er grundig rengjort og installer brystpumpen riktig i henhold til monteringsanvisningen. (Før du ammer kan du bruke et varmt håndkle til å komprimere og stimulere brystene, noe som er bedre for brystpumping.)
2. Plasser den monterte brystpumpen i BH-en og juster den til riktig vinkel slik at den sitter tett inntil brystet (som vist i figur 1).
3. Trykk og hold inne strøm-/fasebryterknappen (**A1**) for å starte maskinen, og brystpumpen vil automatisk gå inn i stimuleringsfasen (standard stimuleringsnivå 3). Etter å ha jobbet i 2 minutter, vil produktet automatisk bytte til utpumpingsfasen (standard utpumpingsnivå 5) (som vist i figur 2).
4. I arbeidstilstand, trykk kort på (**A1**)-knappen for å bytte arbeidsfase syklisk (som vist i figur 3).
5. I arbeidstilstand, trykk kort på knappene (**A2**) og (**A3**) for å justere arbeidsnivået for den gjeldende fasen (som vist i figur 4).



6. I arbeidstilstand trykker du på knappene **(A2)** og **(A3)** samtidig for å legge til «Vibrasjonsfase» i gjeldende arbeidsfase, og trykk igjen for å avbryte vibrasjonsfunksjonen (som vist i figur 4).
7. Minnefunksjon: den kan huske sist brukte stimulerings-, utpumpings-, antistase- og vibrasjonsfase-arbeidsnivå, noe som er praktisk for betjening med én knapp.
8. I arbeidstilstand, trykk og hold inne **(A1)** -knappen for å slå av maskinen.
9. Etter brystpumping, ta av flasken og hell morsmelken i en egnet beholder for oppbevaring (som vist i figur 5).



MERK: Sjekk melkemengden når som helst under prosessen for å sikre at den ikke renner over. Brystpumpen slutter automatisk å virke etter 30 minutter i stimulerings- og utpumpingsfasen. Brystpumpen slutter automatisk å virke etter 5 minutter i antistasefasen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

A. FØR FØRSTE GANGS BRUK

Før du bruker brystpumpen for første gang, må du rengjøre og desinfisere de relevante komponentene unntatt hovedenheten og USB-kabelen, og følge rengjørings- og desinfiseringsinstruksjonene i del **B** og **C** nedenfor.

B. ETTER HVER BRUK

Rengjør alle deler unntatt hovedenheten som kommer i kontakt med bryst og morsmelk. Demonter brystpumpeenheten i separate deler, og skyll alle separate deler som kommer i kontakt med bryst og morsmelk i vann for å fjerne rester av brystmelk.

C. DAGLIG DESINFEKSJON

- Vask hendene grundig.
- Skill alle deler som kommer i kontakt med bryst og morsmelk.
- Hell kaldt vann i kjelen (mengden vann er passende til å senke alle delene ned i).
- Etter at vannet har kokt, legg delene i kokende vann i omtrent 5 minutter, og ta dem deretter forsiktig ut av vannet med en klips.
- Legg de steriliserte delene på overflaten av et rent håndkle.
- Oppbevar dem tørt. Ikke oppbevar dem mørkt og fuktig når de ikke er i bruk.
- Under desinfeksjon må ikke tilbehøret komme i kontakt med metallveggen på potten (ren gasbind kan legges mellom delene og potten).
- Det er også mulig å bruke en dampsterilisator.

FORHOLDSREGLER FOR RENGJØRING

- Vennligst demonter alt tilbehør som kommer i kontakt med bryst eller morsmelk. (unntatt hovedenheten)
- Rengjør delene umiddelbart etter bruk for å unngå melkerester og bakterievekst.
- Når du demonterer eller monterer, må du sørge for å montere/demontere alt tilbehør i henhold til monteringsanvisningen.
- Vær forsiktig med delene når du demonterer og rengjør dem, slik at du ikke mister dem. Dette kan føre til at monteringen eller maskinen ikke fungerer som den skal.
- Stimuleringssilikonet, anti-tilbakestrømssilikonet og annet tilbehør kan legges i sterilisatoren for desinfeksjon (unntatt hovedenheten).
- Forholdsregler for desinfeksjon av ventiler: **IKKE KOK** og dampdesinfisering over lengre tid (ikke mer enn 3 minutter).
- Beholderen er laget av Tritan-materiale og er **IKKE** egnet for varmdampsterilisering; kalde steriliseringsmetoder anbefales i stedet.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktnavn:	1264W Materno Flow
Inngangsspenning:	5V
Vurderingskraft:	6W
Batterispenning:	3,7V
Garanti:	1 år
Batterikapasitet:	1300 mAh 4,81 Wh
Opprinnelsessted:	Kina

GARANTI – VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet er dekket av en 24-måneders garanti mot produksjonsfeil, regnet fra kjøpsdatoen som fremgår av kvittering eller faktura. Ved kjøp med faktura reduseres den lovfestede garantien til 12 måneder. Den 24-måneders garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje, kosmetiske skader, tilbehør eller forbruksvarer (f.eks. batterier, børstehoder eller deler som er utsatt for slitasje). Batterier dekkes av en 6-måneders garanti. De fullstendige garantivilkårene er tilgjengelige på www.nuvitababy.com/warranty

Tak, fordi du har købt den bærbare elektriske brystpumpe Nuvita 1264W. Læs venligst manualen omhyggeligt inden brug, og gem den til senere brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

AF HENSYN TIL DIN OG DINE BØRNS SIKKERHED OG SUNDHED ER ALT INDHOLDET AF DETTE PROJEKT RELATERET TIL SIKKERHED. SØRG FOR AT OVERHOLDE DET.

ADVARSEL

1. Brug ikke brystpumpen i badekarret.
2. Opbevar venligst dette produkt utilgængeligt for børn eller kæledyr.
3. Sørg for, at brystpumpen ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sollys.
4. Hvis produktet er beskadiget, skal det for at undgå fare udskiftes af producenten eller andre fagfolk i vedligeholdelsesafdelinger eller lignende afdelinger.
5. Opbevar alle ubrugte dele utilgængeligt for børn for at undgå at de sluges af børn eller andre farlige ulykker.

FARE

1. Det er forbudt at bruge eller oplade i nærheden af en ildkilde eller i omgivelser, hvor temperaturen overstiger 45 C.
2. Det er forbudt at udsætte værtscomputeren og USB-opladerkablet for væsker, såsom vand, benzin, drikkevarer osv.
3. Det er forbudt at kaste hovedenheden i ilden eller opvarme den.
4. Lad ikke børn lege med produktemballageposen for at undgå kvælningsfare.

MEDDELELSE

- Oplad venligst den, inden du bruger den første gang.
- Sørg for at samle hver del i henhold til samlevejledningen ved montering.
- Indstil sugestyrken i henhold til din personlige fysik, og fuldfør brystpumpearbejdet med behagelig sugning.
- Vip ikke flasken eller fyld den for meget (overskrid ikke den maksimale skalalinje).
- Mål venligst temperaturen på væsken i sutteflasken for at forhindre, at barnet skolder sig, inden du bruger den.
- Brug venligst brystpumpen under vejledning af læger og sygeplejersker, når du ønsker at bruge den i stadiet med lav amning.
- Overam ikke for at undgå brystskader.
- Kontakt venligst din ammespecialist eller læge, hvis der er problemer eller smerter.

- De dele af brystpumpen, der kommer i direkte kontakt med modermælk, er personlige plejeprodukter, og mødre bør ikke dele dem.
- Brug ikke brystpumpe under graviditet, da pumpning af bryst kan føre til spontan abort.
- Fortsæt ikke med at pumpe mælk i mere end 5 minutter, hvis der ikke suges mælk ud.
- Dette produkt er kun til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen.

INFORMATION

Nuvita 1264W Materno Flow er designet til at støtte ammende mødre ved at efterligne barnets naturlige sugerytme. Denne bærbare, elektriske brystpumpe er specielt udviklet til at hjælpe mødre med milkekningsprocessen på en effektiv og behagelig måde – også på farten. Den sikrer en smertefri og bekvem oplevelse og har 9 justerbare intensitetsniveauer, NipFit™-funktion samt 3-faset Careflo™-teknologi.



UAFHÆNGIG VIBRATIONSFASE

Den dedikerede **vibrationsfase** kan bruges uafhængigt til blidt at stimulere brysterne, hvilket hjælper med at stimulere mælkeflowet og lindre ubehag. Den kan også aktiveres under stimulerings-, udpumpnings- eller antistasefaserne for yderligere støtte.



KOMFORTABEL PUMPNING MENS DU LIGGER TILBAGELÆNET

Designet til brug siddende med rygstøtte (læn op til 130° tilbage), hvilket gør pumpeprocessen mere afslappende.



HUDVENLIG SILIKONE BRYSKOP

Udstyret med en 24 mm blød silikonekop, der forsigtigt former sig efter brystet for en sikker og behagelig pasform.



CAREFLO™-TEKNOLOGI:

I modsætning til traditionelle 2-fasede brystpumper introducerer CareFlo™ en tredje dræningsfase mod mælkestau, udover de sædvanlige stimulerings- og udmalkningstrin. Dette hjælper med at:

- Fremme en mere regelmæssig mælkeproduktion.
- Forebygge tilstoppede mælkegange og brystbetændelse (mastitis).
- Lindre spændinger og følelsen af overfyldte bryster.
- Understøtte et mere flydende og uafbrudt ammeforløb.



NIPFIT™-FUNKTION:

Korrektion af flade eller indadvendte brystvorter.

Denne funktion blev udviklet til at korrigere flade eller indadvendte brystvorter og fremme mælkeudvinding gennem blid og progressiv stimulering:

- Hjælper brystvorten med at stikke frem.
- Fremmer korrekt fastgørelse af barnet til brystet.
- Hjælper med at starte og fortsætte amning.

KONTRAINDIKATIONER

Brug ikke NipFit™-funktionen, hvis:

1. Du har åbne sår, revner, læsioner eller aktive infektioner på din brystvorte eller areola.
2. Du har for nylig gennemgået en brystoperation.
3. Du har en diagnosticeret tilstand med brystvorteinversion forårsaget af sygdom eller traume, ikke medfødt. Hvis dette er tilfældet, skal du først kontakte din læge.
4. Du oplever skarpe smerter fra første påføring. Stop brugen med det samme.
5. Du har særlig følsom hud eller lider af lokale dermatologiske tilstande, såsom eksem eller psoriasis.
6. Du er gravid. Sugning kan stimulere veer.



ADVARSEL

NipFit™-funktionen er kun beregnet til brug efter fødslen. Må ikke bruges under graviditet.


ADVARSLER UNDER BRUG

- Start altid på det laveste niveau, niveau 1. Øg ikke intensiteten, før din brystvorte gradvist har tilpasset sig, selvom følelsen er behagelig.
- Brug ikke NipFit™-funktionen kontinuerligt i mere end 5-10 minutter pr. session, især i de første par uger.
- Udfør ikke mere end 2 korrektionssessioner om dagen. Overdreven brug kan forårsage irritation, hævelse eller mikrorifter i brystvorten.
- Stop brugen med det samme, hvis du oplever skarpe smerter, unormal rødme, vedvarende hævelse, blærer eller udskillelse af anden væske end mælk.
- Denne enhed er ikke et certificeret medicinsk udstyr til klinisk behandling og erstatter ikke konsultation med en jordemoder, læge eller International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- En grad 3, alvorligt inverteret brystvorte kræver medicinsk evaluering, før du bruger et korrektionsudstyr.
- Langvarig brug ved høj intensitet kan forårsage hævelse af areolaen, hvilket midlertidigt gør det vanskeligere for din baby at få fat.
- Dette kan have den modsatte effekt af den ønskede.

INSTRUKTIONER TIL SIKKER BRUG:

- Sørg for, at silikonekoppen har den korrekte størrelse, inklusive 24 mm flange eller 20/22 mm reduktionsstykker, før du aktiverer NipFit™-funktionen. En kop, der er for stor, kan øge sugningen på areolaen på en ukontrolleret måde.
- Før behandlingen skal du påføre et par dråber modermælk eller ren lanolincreme for at blødgøre området.
- Under NipFit™-behandlingen skal brystvorten være centreret i koppen.
- Forkert placering kan forårsage asymmetrisk sugning og irritation.
- Hvis du ikke bemærker nogen forbedring efter 4-6 ugers korrekt brug, bør du kontakte din læge eller sundhedsplejerske.

PRODUKTKOMPONENTER






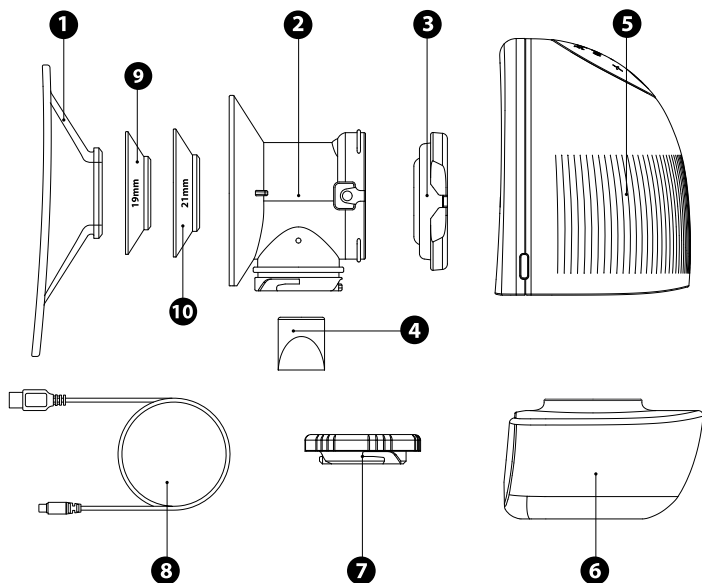


N	NAVN	MATERIALE	TEMPERATURMODSTAND	MÆNGDE
1	Silikonekop	Silikone	-20~200°C	1
2	Monteringsenhed	PP	-20~120°C	1
3	Anti-tilbagestrømningsventil	Silikone	-20~200°C	1
4	Kontraventil	Silikone	-20~200°C	2
5	Hovedenhed	/	/	1
6	Stik	Tritan	-20~105°C	1
7	Kasket	PP	-20~120°C	1
8	USB-kabel	/	/	1
9	Reducer 19mm	Silikone	-20~120°C	1
10	Reducer 21mm	Silikone	-20~120°C	1

MONTERINGSVEJLEDNING

1. Tryk tilbageløbsventilen (3) på samleenheden (2), så hakkene på begge sider flugter med fremspringene på begge sider af samleenheden, og tryk den flad for at sikre en tæt pasform (som vist i figur A).
2. Installer kontraventilen (4) på cylinderen under samleenheden, og monter den helt til enden, så den sidder tæt (som vist i figur B).
3. Ret fremspringet på indersiden af flaskehalsen (6) ind i forhold til rillen under samleenheden, og drej den med uret. Efter montering skal sutteflaskens og samleenhedens midterlinje være sammenfaldende (som vist i figur C).
4. Tryk samleenheden og flaskeenheden ind i hovedenheden i den retning, der er vist på figuren, for at sikre, at de er installeret på plads (som vist i figur D).
5. Ret ▲ på silikonekoppen ind i forhold til ▼ på hovedenheden, og tryk på ringen i midten af silikonekoppen for at sikre, at den sidder tæt ind i samleenheden (som vist i figur E).

BEMÆRK: Kontroller venligst, om det tilhørende tilbehør er samlet korrekt og tæt, inden du pumper brystet.



OPLADNINGSMETODE


Dette produkt bruger et USB-ladekabelgrensesnitt, som kan forsyne strøm på flere måter.

1. Tilsluttes en computers USB-port for brug.
2. Tilsluttes den medfølgende strømadapter (5V2A).
3. Tilslut til en powerbank for brug (brug venligst en powerbank af god kvalitet for at undgå at beskadige dette produkt).

Maskinen genkender automatisk batteriniveauet.

- Hovedenhedens display er forsynet med et batterisymbol, der viser den aktuelle strøm. Hvis strømsymbolet  blinker under opstart eller brug, indikerer det, at hovedenheden skal oplades.
- Efter tilslutning af strømforsyningen til opladning blinker batterisymbolet , hvilket indikerer, at batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batterisymbolet  altid.

BEMÆRK: Sluk for strømmen, og tilslut derefter strømadapteren for at oplade.



BESKRIVELSE AF PANELET

A1: Tænd/fase-knap: Tryk længe for at tænde og slukke, tryk kort for at skifte arbejdsfase

A2: Knap til reduktion af intensitet

A3: Knap til intensitetsforøgelse

A2+A3: I stimulerings-/udtryknings-/antistasefasen trykkes på A2+A3-tasten samtidig for at tilføje den ekstra vibrationsfunktion i den oprindelige arbejdsfase, og tryk igen for at annullere vibrationsfunktionen.

B1: Stimuleringsindikator


B2: Udtryksindikator

B3: Antistasisindikator

B4: Vibrationsindikator

B5: Niveau- og tidsindikator (Når arbejdsfasen skiftes, vises arbejdsniveauet først og derefter arbejdstiden).

B1+B3: NipFit™-funktionen er aktiveret



STIMULERINGSFASE (NIVEAU 1~5): I denne fase genererer pumpen en relativt hurtigt sugerytme med lav sugekraft. Den er designet til blidt at stimulere brystvævet og fremme mælkeudstødning ved at efterligne en babys indledende, overfladiske sugedadfærd. Det anbefales at bruge denne fase, før man skifter til andre faser.

UDMULERINGSFASEN (NIVEAU 1~9): Denne fase efterligner den dybere og langsommere sugerytme hos en baby, når den aktivt drikker mælk. Sugekraften er højere, og frekvensen er langsommere sammenlignet med stimuleringsfasen. Denne indstilling er beregnet til at hjælpe med at udsuge mælk mere effektivt, når mælkeudsugningsrefleksen er startet.

ANTISTASE-SUGNINGSFASEN (NIVEAU 1~9): Denne fase giver et pulserende sugemønster, der har til formål at fjerne resterende mælk i brystet efter udpumpning. Regelmæssig brug kan hjælpe med at forhindre mælkestase, reducere risikoen for tilstoppede mælkegange og opretholde mælkeflowet.



VIBRATIONSFASE (NIVEAU 1~3): Brystpumpen bruger 13.000 blide impulser i minuttet til at stimulere brystet i dybden, hvilket hjælper med at rense mælkekanalerne og lette udtømningen af mælk.

NIPFIT™-FUNKTION: For at aktivere funktionen til korrektion af brystvorter skal du trykke på tilstandsknappen, indtil ikonerne (B1) og (B3) begynder at blinke. Funktionen har 3 intensitetsniveauer.


BEMÆRK: Under stimulerings- og ekstraktionstilstandene fungerer vibrationen med en fast forudindstillet intensitet og kan ikke justeres. Vibrationshastigheden kan kun øges eller mindskes, når kun vibrationstilstanden bruges.

BRUGSANVISNING

1. Vask dine hænder før brug, sørg for at brystpumpens komponenter er grundigt rengjorte, og monter brystpumpen korrekt i henhold til samlevejledningen. (Før du ammer, kan du bruge et varmt håndklæde til at komprimere og stimulere dine bryster, hvilket er bedre til brystpumpning.)
2. Placer den samlede brystpumpe i bh'en, og juster den til den korrekte vinkel, så den sidder tæt til brystet (som vist i figur 1).
3. Tryk på tænd/sluk-/faseknappen **(A1)** og hold den nede for at starte maskinen. Brystpumpen vil automatisk gå i stimuleringsfasen (standard stimuleringsniveau 3). Efter 2 minutter skifter produktet automatisk til udpumpningsfasen (standard udpumpningsniveau 5) (som vist i figur 2).
4. I driftstilstand skal du trykke kort på knappen **(A1)** for at skifte driftsfase cyklisk (som vist i figur 3).
5. I driftstilstand skal du kort trykke på knapperne **(A2)** og **(A3)** for at justere arbejdsniveauet for den aktuelle fase (som vist i figur 4).



6. I driftstilstand skal du trykke på knapperne **(A2)** og **(A3)** samtidig for at tilføje "Vibrationsfase" til den aktuelle driftsfase, og tryk igen for at annullere vibrationsfunktionen (som vist i figur 4).
7. Hukommelsesfunktion: Den kan huske det sidst anvendte stimulerings-, udpumpnings-, antistase- og vibrationsfaseniveau, hvilket er praktisk til betjening med én knap.
8. I driftstilstand skal du trykke på knappen **(A1)** og holde den nede for at slukke maskinen.
9. Efter brystpumpning skal du tage flasken af og hælde brystmælken i en egnet beholder til opbevaring (som vist i figur 5).



BEMÆRK: Kontroller mælkemængden når som helst under processen for at sikre, at den ikke løber over. Brystpumpen stopper automatisk efter at have arbejdet i stimulerings- og udpumpningsfaserne i 30 minutter. Brystpumpen stopper automatisk efter 5 minutter i antistasefasen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

A. FØR FØRSTE BRUG

Før du bruger brystpumpen for første gang, skal du rengøre og desinficere de relevante komponenter undtagen hovedenheden og USB-kablet, og følge rengørings- og desinfektionsvejledningen i afsnit **B** og **C** nedenfor.

B. EFTER HVER BRUG

Rengør alle dele undtagen hovedenheden, der kommer i kontakt med bryst og brystmælk. Skil brystpumpeenheten ad i separate dele, og skyl alle separate dele, der kommer i kontakt med bryst og brystmælk, i vand for at fjerne rester af brystmælk.

C. DAGLIG DESINFEKTION

- Vask dine hænder grundigt.
- Adskil alle dele, der kommer i kontakt med bryst og modermælk.
- Hæld koldt vand i gryden (mængden af vand er passende til at nedsænke alle dele).
- Når vandet er kogt, læg delene i kogende vand i cirka 5 minutter, og tag dem derefter forsigtigt op af vandet med en klips.
- Læg de steriliserede dele på overfladen af et rent håndklæde.
- Opbevar dem tørt. Opbevar dem ikke mørkt og fugtigt, når de ikke er i brug.
- Under desinfektion må tilbehøret ikke berøre pottens metalvæg (der kan lægges rent gazebind mellem delene og potten).
- Det er også muligt at bruge en dampsterilisator.

FORHOLDSREGLER VED RENGØRING

- Adskil venligst alt tilbehør, der kommer i kontakt med bryst eller modermælk (undtagen hovedenheden).
- Rengør delene straks efter brug for at undgå mælkerester og bakterievækst.
- Sørg for at samle/afmontere hvert tilbehør i henhold til samlevejledningen ved adskillelse eller montering.
- Vær forsigtig med delene ved adskillelse og rengøring for at undgå at miste dem, da dette kan føre til fejl i monteringen eller maskinens funktion.
- Stimuleringssilikon, anti-tilbageløbssilikon og andet tilbehør kan lægges i sterilisatoren til desinfektion (undtagen hovedenheden).
- Forholdsregler ved desinfektion af ventiler: **MÅ IKKE** koges eller dampdesinfektionsmidler i længere tid (højest 3 minutter).
- Beholderen er lavet af Tritan-materiale og er **IKKE** egnet til varmdampsterilisering; koldsterilisering anbefales i stedet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktnavn:	1264W Materno Flow
Indgangsspænding:	5V
Vurderingskraft:	6W
Batterispænding:	3,7V
Garanti:	1 år
Batterikapacitet:	1300mAh 4,81Wh
Oprindelsessted:	Kina

GARANTI – VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af en 24-måneders garanti mod fabrikationsfejl, der gælder fra købsdatoen som angivet på kvitteringen eller fakturaen. Hvis produktet er købt med faktura, er den lovbestemte garanti begrænset til 12 måneder. Den 24-måneders garanti dækker ikke skader som følge af almindelig slitage, kosmetiske skader, tilbehør eller forbrugsvarer (f.eks. batterier, børstehoveder eller dele, der er udsat for slitage). Batterier er dækket af en 6-måneders garanti. De fulde garantibetingelser findes på www.nuvitababy.com/warranty



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DA:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar. **HU:** Töltse le vagy tekintse meg online a használati útmutatót az Ön által választott nyelven. **CZ:** Stáhněte si nebo prohlédněte návod k použití online ve vašem preferovaném jazyce. **SI:** Prenesite ali si oglejte navodila za uporabo na spletu v želenem jeziku. **BG:** Изтеглете или прегледайте ръководството за употреба онлайн на предпочитания от вас език. **SK:** Stiahnite si alebo pozrite si návod na použitie online vo vašom preferovanom jazyku. **RO:** Descărcați sau vizualizați manualul de instrucțiuni online în limba preferată.



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved

1264W_26_Manual_v2.0.0